



Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Arad, OU=Administrativ,
E=scjaradsecretariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autenticate
Computerul meu
2020.05.22 16:42

Achizitionare echipamente medicale (5 loturi) - Lotul 4

2 mesaje

Simona Neagu <simona.neagu@hellimed.ro>

6 aprilie 2020, 09:05

Către: scjuarad.bap@gmail.com

Cc: ofertare@hellimed.ro

Buna ziua,

Va transmitem atasat oferta noastra pentru negocierea nr. 12266/01.04.2020.

Va multumim!

O zi buna,

Ing. Simona Neagu

Reprezentant tehnic

HELLIMED

SC HELLIMED SRL

Str. Tudor Vianu 5-7, Sector 1

Bucharest, Romania.

Mobil: 0040731489688

Tel/fax: 0040730072278 / 0040212246714

Email: simona.neagu@hellimed.ro

www.hellimed.ro



Achizitionare echipamente medicale (5 loturi) - Lotul 4 Injectomat cu baterie.zip
10474K

spital <scjuarad.bap@gmail.com>

6 aprilie 2020, 13:36

Către: cerasela buzatu <cerasela_buzatu@yahoo.com>

----- Forwarded message -----

De la: **Simona Neagu** <simona.neagu@hellimed.ro>

Date: lun., 6 apr. 2020 la 09:55

Subject: Achizitionare echipamente medicale (5 loturi) - Lotul 4

To: <scjuarad.bap@gmail.com>

Cc: <ofertare@hellimed.ro>

[Textul citat a fost ascuns]



Achizitionare echipamente medicale (5 loturi) - Lotul 4 Injectomat cu baterie.zip

10474K



HELLIMED SRL

Tudor Vianu nr. 5-7, district 1, 011635 - Bucuresti

Tel: +4021-224.67.14; Fax: +4021-665 27 01 ;

Mobil: +40730.072.278

Email: office@hellimed.ro . www.hellimed.ro

HELLIMED

Formular nr. 1

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR REFERITOARE LA CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIA MUNCII

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant împuternicit al **S.C. HELLIMED S.R.L., str. Tudor Vianu, nr. 5-7, sector 1, Bucuresti** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și ne angajăm să respectăm aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, respectiv din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în România.

Data completării **03.04.2020**

Operator economic,

S.C. HELLIMED S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
Ec. IONASCU DOINA



DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant împuternicit al **S.C. HELLIMED S.R.L.**, în calitate de ofertant la procedura de *negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare* pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect **Achiziționare echipamente medicale (5 loturi) – lot 4 Injectomat cu baterie**, cod CPV **Echipamente medicale (Rev.2)**, din data de **06.04.2020**, declar pe proprie răspundere, că:

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98/2016 cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția detinuta in cadrul Comisiei de evaluare
1	Duna Flaviu	/Presedinte fara drept de vot Comisie de ev.
2	Voinitchi Alina	/Membru Comisie de ev.
3	Crisan Adrian	Medic /Membru Comisie de ev.
4	Gulyas Albu Mihaela	Medic/Membru Comisie de ev.
5	Nicolescu Cristian	Medic /Membru supleant Comisie de ev.
6	Buzatu Cerasela	Medic /Membru supleant Comisie de ev.
7	Carmen Alina Lucuta	Manager
8	Mircea Onel	Director medical
9	Florina Ionescu	Director Financiar Contabil
10	Emilia Otilia Popa	Director ingrijiri medicale
11	Daniel Kurunczi	Director Direcția Patrimoniu și Achiziții Publice
12	Simona Virciu	Consilier Juridic
13	Coseri Claudiu	Inginer/Membru supleant Comisie de ev.

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data completării **03.04.2020**

Operator economic,

S.C. HELLIMED S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
Ec. IONASCU DOINA



DECLARAȚIE

de neincadrare în situațiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98 /2016 privind achizițiile publice

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant împuternicit al, **SC HELLIMED SRL**, în calitate de **ofertant**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din LEGEA 98 /2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia din următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹-18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nici o persoană care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD** sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă.

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

SC HELLIMED SRL Str. Tudor Vianu nr. 5-7, sector 1, 011635 - Bucuresti



HELLIMED SRL
Tudor Vianu nr. 5-7, district 1, 011635 - Bucuresti
Tel: +4021-224.67.14; Fax: +4021-665 27 01 ;
Mobil: +40730.072.278
Email: office@hellimed.ro . www.hellimed.ro


HELLIMED

Tel: 021-224.67.14; Fax: 021-665 27 01 ; Mobil: 0730.072.278

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 03.04.2020

Operator economic,
SC HELLIMED SRL
DIRECTOR GENERAL
Ec. IONASCU DOINA

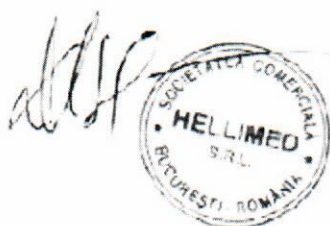

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant împuternicit al **SC HELLIMED SRL, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, ap. 2, sector 1, Bucuresti**, în calitate de ofertant la procedura de *negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare* pentru atribuirea contractului de achiziție publica avand ca obiect **Achiziționare echipamente medicale (5 loturi) – lot 4 Injectomat cu baterie**, la data de **06.04.2020**, organizată de **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD**, declar pe propria răspundere că nu am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat și nu există în acest sens o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 03.04.2020

Operator economic,
SC HELLIMED SRL
DIRECTOR GENERAL
Ec. IONASCU DOINA



DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant împuternicit al **SC HELLIMED SRL, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, ap.2, sector 1, Bucuresti**, în calitate de ofertant la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect **Achiziționare echipamente medicale (5 loturi) – lot 4 Injectomat cu baterie**, la data de **06.04.2020**, organizată de **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD**, declar pe propria răspundere că nu sunt in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice.

ART. 167

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce

permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6).

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprie utilizării conform destinației prevăzute în contract.

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 03.04.2020

Operator economic,



SC HELLIMED SRL
DIRECTOR GENERAL
Ec. IONASCU DOINA



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



BRB2XETS7

Nr.: 195807/03.04.2020

Oficiul

National al

Registrului

Comerțului

Digitally signed

by Oficiul

National al

Registrului

Comerțului

CERTIFICAT CONSTATATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 195807 din 03.04.2020, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

Location:

Bucuresti

HELLIMED SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3336/1997, atribuit în data de 05.05.1997

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/3336/1997

Cod unic de înregistrare: 4885207

Certificat de înregistrare: B3187666, emis pe data de 18.01.2016 și eliberat la data 18.01.2016

Adresă sediu social: București Sectorul 1, Strada TUDOR VIANU, Nr. 5-7, Etaj 1, Ap. 2

Contacte sediu social: telefon: 0730072278, 0725214389

Contacte firmă: telefon: 0730072278, 0725214389

Actul de înmatriculare și autorizare: Sentință civilă / Hotărâre judecătorească 3704/1993, TIMISOARA

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 24.07.2018

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de închiriere, nr. 3176 din data 17.12.2015

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.12.2015.

Data expirării dovezii de sediu: 17.12.2040.

Durata sediului: 25 ani.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 122000 LEI , integral vărsat

Structura capitalului:

LEI: capital social: 81862, integral vărsat

DOLAR S.U.A.: capital social: 4000, integral vărsat

Echivalent USD capital social: 4000

Număr părți sociale: 122

Valoarea unei părți sociale: 1000 LEI

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.



BRB2XETS7

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

IONASCU BOGDAN FLORIN

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: necasatorit

Data și locul nașterii: 25.06.1981, CONSTANTA

Sex: masculin

Aport la capital: 61000 LEI

Structura capitalului:

LEI: capital social: 40931

DOLAR S.U.A.: capital social: 2000

Echivalent USD capital social: 2000

Aport vărsat total: 61000 LEI

Număr părți sociale: 61

Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

IONASCU DOINA

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 15.11.1958, CONSTANTA

Sex: feminin

Aport la capital: 61000 LEI

Structura capitalului:

LEI: capital social: 40931

DOLAR S.U.A.: capital social: 2000

Echivalent USD capital social: 2000

Aport vărsat total: 61000 LEI

Număr părți sociale: 61

Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

IONASCU BOGDAN FLORIN

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 25.06.1981, CONSTANTA

Puteri: DEPLINE

Data numirii în funcție: 03.12.2003

Durată mandat: nelimitată

Dată depunere specimen semnătură: 18.07.2003

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

IONASCU DOINA - IMPUTERNICIT

Calitate: administrator



BRB2XETS7

Funcție: nespecificata
Cetățenie: română
Sex: feminin
Data și locul nașterii: 15.11.1958, CONSTANTA
Data numirii în funcție: 29.04.1997
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Denumire: Punct de lucru
Adresă: București Sectorul 1, Strada TUDOR VIANU, Nr. 5-7, Etaj 1, Ap. 3
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 0659 din data 08.03.2017
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 08.03.2017.
Data expirării dovezii de sediu: 08.03.2042.
Durata sediului: 25 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Tip activitate autorizată: terți
Conform declarației - tip model 3 nr. 409961 din 20.07.2018
Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
5210 - Depozitări
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
Data certificatului constatator: 24.07.2018

Sediul social din: București Sectorul 1, Strada TUDOR VIANU, Nr. 5-7, Etaj 1, Ap. 2
Tip sediu: principal
Tip model declarație: model 3 nr. 481127 din 30.12.2015
desfășoară activități proprii de birou pentru societate
Activități la sediu:

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Data certificatului constatator: 18.01.2016

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: București Sectorul 1, Strada TUDOR VIANU, Nr. 5-7, Etaj 1, Ap. 3

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 149390 din 05.04.2017

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Activități la sediu:

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
Data certificatului constatator: 06.04.2017

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019

Nu există înregistrări.

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 03.04.2020

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului IONASCU DOINA , fiindu-i necesar la Licitatie.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

*Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.*

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



**AVIZ DE FUNCȚIONARE
Nr. 5435 din 28.08.2018**

În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza documentației înaintate, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale avizează funcționarea unității

SC HELIMED SRL

cu sediul social în București, Str. Tudor Vianu nr.5-7, etaj 1, ap.2, sector 1 și punct de lucru în București, Str. Tudor Vianu nr.5-7, etaj 1, ap.3, sector 1
pentru activități de:

import dispozitive medicale

DA	NU
----	----

 ;

distribuție dispozitive medicale

DA	NU
----	----

 ;

depozitare dispozitive medicale

DA	NU
----	----

 ;

protezare

DA	NU
----	----

 : ☐ ortopedică; ☐ auditivă; ☐ alte tipuri;

optică medicală

DA	NU
----	----

 ;

reparare, mentenanță și punere în funcțiune/instalare

DA	NU
----	----

pentru dispozitive medicale din următoarele domenii :

-ATI (aparate de anestezie, aparate ventilatie pulmonara, defibrilatoare, incubatoare nou nascuti, monitoare functii vitale, mese de terapie intensiva, unitate mobila de aspiratie, pulsoximetre, paturi terapie intensiva, injectomate-infuzomate, statii de monitorizare)

-electromecanice (unituri ORL, scaun ORL, dispozitive de masura a emisiilor otoacustice tranzitorii, dispozitive de stimulare calorica cu jet de aer,

videonistamografe, microscop optic, ochelari Frenzen, endoscoape video, dispozitive diagnostic tulburari de echilibru, audiometre, timpanometre, sisteme electrofiziologie, sisteme hemodinamice, dispozitive testare efort, holtere EKG, holtere TA, spirometre, EKG-uri, EEG-uri, electromiografe)
 -uz medical / general spitalicesc (paturi electrohidraulice, targi)
 -reutilizabile pentru chirurgie (mese de operatie, lampi de operatie)

Unitatea este distribuitor al producătorilor:

Nume producator	Tara	N	SH	CR
ARMSTRONG MEDICAL LTD	IRLANDA	Da		
ARTHROCARE CORPORATION	S.U.A.	Da		
BAITELLA AG	ELVETIA	Da		
BARD PERIPHERAL VASCULAR INC.	S.U.A.	Da		
BIOSENSE WEBSTER INC.	S.U.A.	Da		
BREMED LIMITED	CHINA	Da		
CAREFUSION INC.	S.U.A.	Da		
CORDIS CORPORATION	S.U.A.	Da		
CORTEX BYOPHYSIK GMBH	GERMANIA	Da		
DATEX OHMEDA INC.	S.U.A.	Da		
DEYMED DIAGNOSTIC SRO	CEHIA	Da		
DIAGRAMM HALBACH GMBH & CO. KG	GERMANIA	Da		
ERGOLINE GMBH	GERMANIA	Da		
FRITZ STEPHAN GMBH	GERMANIA	Da		
GE HEALTHCARE FINLAND OY	FINLANDA	Da		
GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES INC.	S.U.A.	Da		
GETEMED MEDIZIN UND INFORMATIONSTECHNIK AG	GERMANIA	Da		
GINEVRI SRL	ITALIA	Da		
HAPPERSBERGER OTOPRONT GMBH	GERMANIA	Da		
HAROL SRL	ITALIA	Da		
JOLIFE AB	SUEDIA	Da		
K.H.DEWERT GMBH	GERMANIA	Da		
MEDIMA SP.ZOO	POLONIA	Da		
MEKICS CO.LTD	COREEA	Da		
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC.	S.U.A.	Da		
MEYSA MEDIKAL MOBILYA VE SAGLIK HIZMETLERI METAL MAKINE IMALAT ITHALAT IHRACAT SAN.TIC.A.S.	TURCIA	Da		
NDD MEDIZINTECHNIK AG	ELVETIA	Da		

Nume producator	Tara	N	SH	CR
NOVOS TIBBI CIZAHLAR SANAYI VE TICARET ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI	TURCIA	Da		
OPT SURGISYSTEMS SRL	ITALIA	Da		
ORIDION MEDICAL 1987 LTD	ISRAEL	Da		
PAR MEDIZINTECHNIK GMBH	GERMANIA	Da		
PHYSIO-CONTROL INC.	S.U.A.	Da		
QISDA CORPORATION	TAIWAN	Da		
S.I.M.E.O.N. MEDICAL GMBH & CO.KG	GERMANIA	Da		
SCHULZE & BOHM GMBH	GERMANIA	Da		
SHENZHEN INSIGHTERS MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD.	CHINA	Da		
STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES SAS	FRANTA	Da		
STOCKERT GMBH	GERMANIA	Da		
VASCOMED GMBH	GERMANIA	Da		

Unitatea este reprezentant autorizat în Uniunea Europeană al producătorului:

Nu este cazul.

Orice modificare a condițiilor stabilite prin reglementările Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care au stat la baza avizării, atrage anularea prezentului aviz de funcționare.

Valabilitatea prezentului aviz poate fi verificata prin solicitare scrisa adresata Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

PRESEDINTE,
DR. ALEXANDRU VELICU





**ANEXA din data 20.09.2019
LA AVIZUL DE FUNCȚIONARE
Nr. 5435/28.08.2018 al HELLIMED SRL**

În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și în baza documentației înaintate, Avizul de functionare nr. 5435/28.08.2018 se completează după cum urmează:

Unitatea este distribuitor al producătorilor:

Nume producator	Tara	N	SH	GR
AESCLAP AG	GERMANIA	Da		
APOLLO ENDOSURGERY INC.	S.U.A.	Da		
ARMSTRONG MEDICAL LTD	IRLANDA	Da		
ARTHROCARE CORPORATION	S.U.A.	Da		
ASCOM UMS SRL UNIPERSONALE	ITALIA	Da		
AUGUSTINE BIOMEDICAL + DESIGN, LLC. DBA AUGUSTINE TEMPERATURE MANAGEMENT	S.U.A.	Da		
B.BRAUN MELSUNGEN AG	GERMANIA	Da		
BAITELLA AG	ELVETIA	Da		
BARD PERIPHERAL VASCULAR INC.	S.U.A.	Da		
BIOSENSE WEBSTER INC.	S.U.A.	Da		
BOVIE MEDICAL CORPORATION	S.U.A.	Da		
BREMED LIMITED	CHINA	Da		
CAREFUSION INC.	S.U.A.	Da		
CORDIS CORPORATION	S.U.A.	Da		
CORTEX BYOPHYSIK GMBH	GERMANIA	Da		
COVIDIEN II c	S.U.A.	Da		
DATEX OHMEDA INC.	S.U.A.	Da		
DEYMED DIAGNOSTIC SRO	CEHIA	Da		
DIAGRAMM HALBACH GMBH & CO. KG	GERMANIA	Da		
ERGOLINE GMBH	GERMANIA	Da		
FIAB SPA	ITALIA	Da		
FINAPRES MEDICAL SYSTEMS BV	OLANDA	Da		
FRITZ STEPHAN GMBH	GERMANIA	Da		
GE HEALTHCARE FINLAND OY	FINLANDA	Da		
GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES INC.	S.U.A.	Da		
GERIUM MEDICAL LTD	ISRAEL	Da		
GETEMED MEDIZIN UND INFORMATIONSTECHNIK AG	GERMANIA	Da		

Nume producator	Tara	N	SH	CR
GINEVRI SRL	ITALIA	Da		
HAPPERSBERGER OTOPRONT GMBH	GERMANIA	Da		
HAROL SRL	ITALIA	Da		
HERSILL S.L.	SPANIA	Da		
JOLIFE AB	SUEDIA	Da		
K.H.DEWERT GMBH	GERMANIA	Da		
MAXTEC	S.U.A.	Da		
MEDIMA SP.ZOO	POLONIA	Da		
MEKICS CO.LTD	COREEA	Da		
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC.	S.U.A.	Da		
MEYSA MEDIKAL MOBILYA VE SAGLIK HIZMETLERI METAL MAKINE IMALAT ITHALAT IHRACAT SAN.TIC.A.S.	TURCIA	Da		
NDD MEDIZINTECHNIK AG	ELVETIA	Da		
NOVOS TIBBI CIZAHLAR SANAYI VE TICARET ITHALAT VE IHRACAT LIMITED SIRKETI	TURCIA	Da		
OPT SURGISYSTEMS SRL	ITALIA	Da		
ORIDION MEDICAL 1987 LTD	ISRAEL	Da		
PAR MEDIZINTECHNIK GMBH	GERMANIA	Da		
PHYSIO-CONTROL INC.	S.U.A.	Da		
PRIME MEDICAL LLC	S.U.A.	Da		
QISDA CORPORATION	TAIWAN	Da		
S.I.M.E.O.N. MEDICAL GMBH & CO.KG	GERMANIA	Da		
SALVIA MEDICAL GMBH & CO. KG	GERMANIA	Da		
SCHULZE & BOHM GMBH	GERMANIA	Da		
SHENZHEN INSIGHTERS MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD.	CHINA	Da		
SOLARIS MEDICAL TECHNOLOGY INC	CHINA	Da		
STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES SAS	FRANTA	Da		
STOCKERT GMBH	GERMANIA	Da		
STRYKER MEDICAL	S.U.A.	Da		
SUNTECH MEDICAL INC.	S.U.A.	Da		
SYMMETRY SURGICAL INC.	S.U.A.	Da		
VASCOMED GMBH	GERMANIA	Da		
VYAIR MEDICAL INC.	S.U.A.	Da		
ZD MEDICAL INC.	CHINA	Da		

Prezentul document este valabil numai însoțit de avizul inițial.

PRESEDINTE,

Marius Daniel ȘIȘU



CERTIFICAT CE
Sistem complet de asigurare a calității
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, anexa II, cu excepția (4)

Nr. 5-871-200-1911

Direcția de Testare a Dispozitivelor și Inginerie Clinică (EMKI)

certifică faptul că producătorul:

MEDIMA Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Varșovia
Polonia

pentru produsele / categoriile de produse:

Pompe de perfuzie cu seringă
Pompe de perfuzie volumetrică
Stații de andocare pentru pompe de perfuzie
Seturi de perfuzie
Aplicații informatice pentru echipamente medicale

aplică un sistem de calitate care îndeplinește cerințele Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, anexa II.

Numărul de înregistrare al raportului de audit aferent: **42-131-2007**

Acest certificat este valabil până la **26.05.2024**, presupunând că rezultatele auditurilor obișnuite de supraveghere anuală sunt satisfăcătoare.

Eliberat de EMKI ca organism notificat cu numărul de identificare **1011**.

Acest certificat este valabil numai cu anexa.

Budapesta, 20.11.2019

//semnătură indescifrabilă
//ștampila rotundă
Șeful EMKI


EMKI 2263

Autenticitatea și validitatea certificatului pot fi verificate la EMKI.

Eszközminősítő és Korhaztechnikai Igazgatóság
Direcția de Testare a Dispozitivelor și Inginerie Clinică

H-1097 Budapesta, Albert Florian ut 3 / A. Telefon: +36 20 268 75 95, Fax: +36 1 886 93 33 E-mail: cert@emki.hu. Web:
www.emki.hu

H-1051 Budapesta, Zrínyi u. 3. (1372 Căsuța poștală 450.)



ANEXĂ LA CERTIFICATUL CE

Pagina 1 din 1

Informații suplimentare pentru certificatul 5-871-200-1911

Certificatul este valabil pentru următorul punct de fabricație:

MEDIMA Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Varșovia
Polonia

Certificatul este valabil pentru următoarele modele:

Pompe de perfuzie cu seringă:
S100, S200, S300, S300 PCA

Pompe de perfuzie volumetrice:
P, P1, P2, P100, P200, P300

Stații de andocare pentru pompe de perfuzie:
DS302, DS304, DS306, DS308

Seturi de perfuzie:
Medima Line S
Medima Line L
Medima Line B
Medima Line

Aplicații informatice pentru echipamente medicale:
Medima User ToolBox
Medima Service ToolBox
MedimaNet

Descrierea detaliată a produselor este păstrată de EMKI sub nr. 42-131-2007.

Ediție: 1

Data: 20.11.2019

Prima ediție: 20.11.2019

//semnătură indescifrabilă
//ștampila rotundă
Șeful EMKI

EMKI

Eszkozminosito es Korhaztechnikai Igazgatosag
Direcția de Testare a Dispozitivelor și Inginerie Clinică

II-1097 Budapest, Albert Florian ut 3 / A, Telefon: +36 20 268 75 95, Fax: +36 1 886 93 33 E-mail: cert@emki.hu, Web:
www.emki.hu

II-1051 Budapest, Zrínyi u. 3. (1372 Căsuța poștală 450.)



Declarație de conformitate CE

PRODUCĂTOR: MEDIMA Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Varșovia, Polonia

PRODUSE MEDICALE: Pompe de infuzie seringă
Modele: S100, S200, S300, S300 PCA

CLASIFICARE: Clasa IIb, dispozitive active- regula 11,
potrivit anexei IX a Directivei privind dispozitivele medicale (93/42/CEE)

Declarăm prin prezenta că dispozitivele medicale menționate mai sus respectă cerințele esențiale și prevederile Directivei privind dispozitivele medicale (93/42/CEE) cu modificările ulterioare.

Au fost aplicate următoarele standarde de referință:

- 1) EN 60601-1: 2006
- 2) EN 60601-1-2:2007
- 3) EN 60601-2-24:2015
- 4) EN 60601-1-8:2007/a1:2013
- 5) EN 62304:2006+AC:2008
- 6) EN 62366:2008
- 7) EN 1789:2007+A2:2014
- 8) EN 1041:2008+A1:2013
- 9) EN ISO 14971:2012
- 10) EN ISO 15223-1:2012

Procedura de evaluare a conformității s-a desfășurat conform anexei II a reglementărilor (directivei) menționate mai sus, sub supravegherea organismului notificat nr. 1011:

Institutul National de Farmacie și Nutriție (ogyeu)– Directoratul pentru Testarea Dispozitivelor și Inginerie Clinică (EMKI)

Certificat de sistem de management al calității în conformitate cu cerințele
EN ISO 13485:2012: Nr. 4-439-135-1611

Certificat CE în conformitate cu anexa II secțiunea 3 din Directiva 93/42/CEE a Consiliului cu modificările ulterioare: Nr. 5-768-200-1411

Varșovia, 23 noiembrie 2016

Maciej Grabowski
Semnătură de mână ilizibilă
Președinte al Consiliului de Administrație al
Medima Sp. z o.o.

DZCE 102


MEDIMA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Varșovia, Polonia
Tel. +48 22 313 22 66, Fax. +48 22 313 22 69
E-mail: medima@medirna.pl, www.medima.pl

Nr. TVA: PL 5222709842, Nr. de înregistrare de la Curtea locală de la Varșovia : 0000201189
Capital inițial: 300 000,00 PLN Capital vărsat: 300 000,00 PLN

E0002041WZ

PROPUNERE TEHNICA

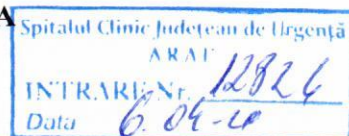

Lot 4: Injectomat cu baterie

Nr. crt.	Descriere tehnica	Da	Nu	Conformitate
1	Debite infuzie: 50-1200 ml/h in mod normal	da		Manual Injectomat Medima pag. 71: Debit 0.01 – 2000 ml/h
2	Valoare bolus: debit: 0.1 – 1200 ml/h	da		Manual Injectomat Medima pag. 71: Valoare bolus debit: 0.01 – 2000 ml/h
3	Volum de infuzie cumulat: 0.1-999.9 ml	da		Manual Injectomat Medima pag. 71: Volum de infuzie: 0.1 – 20 000 ml
4	Alimentare: AC 220 V; 50/60 Hz	da		Manual Injectomat Medima pag. 73: AC 100-240 V, 50/60 Hz
5	Baterie NiMH reicarcabila: 6 V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa	da		Manual Injectomat Medima pag. 72: Baterie reincarcabila NiMH capacitate 2 Ah, incarcare completa in mai putin de 5 ore si functionare 30 ore la o rata de 5 ml/h Manual Injectomat Medima pag. 73 DC 12.4-15.5 V
6	Informatia afisata: debit seringa, volumul acumulat, dimensiune seringa, capacitate baterie, indicator curent AC, numar pat	da		Manual Injectomat Medima pag. 26: Informatia afisata: pct 3 debit, pct 4 volumul infuzat, pct 7 tipul seringii, producator si volum, pct 2 medicamentul administrat, pct 5 nivelul bateriei, pct 6 indicator conexiune curent AC, pct 2 denumirea sectiei (poate fi introdus numarul patului)
7	Alarmer: la completare, apropiere completare, ocluzie, baterie descarcata, seringa anormala, functionare defectuoasa	da		Manual Injectomat Medima pag. 58-59: Alarma: doza administrata, ocluzie, seringa goala, seringa anormala, fara seringa, baterie descarcata Manual Injectomat Medima pag. 61-63: aproapiere doza completata, functionare defectuoasa

Data completării 03.04.2020

Operator economic,
S.C. HELLIMED S.R.L.
Director General,
Ec. DOINA IONASCU



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, reprezentant legal al **HELLIMED SRL** cu sediul in **Bucuresti, str. Tudor Vianu, nr.5-7, ap.2, sector 1**, cu referire la procedura de *negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare* pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect **Achiziționare echipamente medicale (5 loturi) – lot 4 Injectomat cu baterie**, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale:

- Echipamentele oferate sunt noi, iar in cazul in care oferta noastra va fi stabilita castigatoare echipamentele ce vor fi livrate vor fi noi si vor corespunde cu caracteristicile mentionate in propunerea tehnica;
- Perioada de garantie este de **24 luni** de la data punerii in functiune;
- Beneficiarul are dreptul de a notifica in scris orice plangere sau reclamatie ce apare in coformitate cu aceasta garantie in termen de maxim 5 zile de la data constatarii lor. La primirea unei astfel de notificari, Hellimed SRL are obligatia de a inlocui produsul necorespunzator in maxim 15 zile, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsele care pe timpul garantiei le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii lor si semnarii procesului verbal de receptie/ punere in functiune si va acoperi perioada de garantie initiala.
- Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie inclusiv dar fara a se limita la: demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei, ambalaje inclusiv furnizarea de material protector pentru transport, transport, diagnoza defectelor inclusiv costurile de personal, repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente, inlocuirea partilor defecte, despachetarea inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia, instalarea in starea initiala, testarea pentru a asigura functionarea corecta, repunerea in functiune;
- Termenul de livrare a produselor este de maxim **60 de zile** de la data emiterii comenzii ferme de catre achizitor. La livrare se va intocmi proces verbal de receptie cantitativa.
- Echipamentele vor fi livrate cantitativ si calitativ catre Autoritatea contractanta la locul indicat de catre acesta. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.
- La livrare, echipamentul va fi insotit de manual de utilizare ce include instructiuni de exploatare, intretinere si service.
- Produsele furnizate vor fi ambalate si etichetate astfel incat sa se previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Ambalajul va fi prevazut astfel incat sa reziste fara limitare manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. În stabilirea marimii si greutatii ambalajului, se va lua in considerare acolo unde este cazul distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.
- Transportul si toate costurile asociate sunt suportate exclusiv de SC Hellimed SRL. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.
- Destinatia de livrare este cea mentionata in comanda ferma pe care achizitorul o va transmite furnizorului;

- Hellimed SRL este responsabil pentru livrarea in termenul agreeat al produselor si se considera ca a avut in vedere toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.
- De la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa in termen de **maxim 2 zile** furnizorul are obligatia de a efectua urmatoarele activitati si de a intocmi: instalarea echipamentului, punerea in functiune si verificarea tehnica privind incadrarea in conditiile de acceptabilitate a echipamentului. Toate acestea se vor realiza cu personal autorizat si sunt incluse in pretul de achizitie a echipamentului; proces verbal de instalare si punere in functiune; proces verbal de receptie calitativa; emiterea buletinului de verificare tehnica;
- Furnizorul va instala toate produsele in mod corespunzator, asigurandu-se in acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor, furnizorul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare;
- Odata ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza apoi toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima.
- Dupa instalare si punere in functiune, Autoritatea contractanta impreuna cu furnizorul vor efectua teste functionale ale produsului.
- Hellimed SRL va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de cost suplimentar din partea Autoritatii contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametrii agreeati. Furnizorul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari pana la acceptare de catre Autoritatea contractanta.
- Se vor instrui 6 persoane din cadrul personalului medical in limba romana, operatiune ce este inclusa in pret. Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional si va permite personalului spitalului sa inteleaga: componentele echipamentului, functionarea si operarea echipamentului; sa detina informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator, sa fie instruit in vederea depistarii problemelor si diagnosticarea lor de baza.
- Durata sesiunii de instruire va fi pana in momentul in care persoanele instruite vor fi capabile sa utilizeze echipamentele. Sesiunea de instruire va fi efectuata in limba romana.
- Pe toata durata contractului in perioada de garantie, SC Hellimed SRL va asigura suport tehnic. Se va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii contractante prin SCJU Arad in calitate de beneficiar, unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesita mentenanta preventiva sau solicita suport tehnic furnizorului in gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este tratata cu promptitudine.
- SC Hellimed SRL va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractanta prin SCJU Arad in calitate de beneficiar in functie de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate care va evidentia impactul acestuia asupra functionalitatilor produsului. Nivele de prioritate sunt: URGENT, CRITIC, MAJOR si MINOR.
- Furnizorul va asigura disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. In cazul incidentelor cu prioritate „urgent” interventia va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizarii si pana la remedierea definitiva a problemei si asigurarea functionalitatii integrale a produsului.
- Contractantul va trebui sa respecte urmatoorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a incidentului astfel:

Nivel prioritate	Timp de raspuns	Timp de implemnatare solutie provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	urmatoarea zi lucratoare	urmatoarea zi lucratoare
Minor	6 ore	a doua zi lucratoare	a doua zi lucratoare

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnata, **IONASCU DOINA**, autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, etc, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai **SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD**, cu privire la orice aspect tehnic si financiar.

Data completării 03.04.2020

Operator economic,
SC HELLIMED SRL
DIRECTOR GENERAL
Ec. IONASCU DOINA



**HELLIMED SRL**

Tudor Vianu nr. 5-7, district 1, 011635 - Bucuresti

Tel: +4021-224.67.14; Fax: +4021-665 27 01 ;


Mobil: +40730.072.278

Email: office@hellimed.ro . www.hellimed.ro**HELLIMED****DETALII PRODUCATOR**

Denumire produs: Injectomat Medima S300

Nr. crt.	Informatii solicitate	Raspuns
1	Denumire producator	MEDIMA Sp z o.o.
2	Tara de resedinta a producatorului – Adresa postala	Al. Jerozolimskie 200 02-486 Varşovia, Polonia
3	Tara/adresa/unitatii de productie	Al. Jerozolimskie 200 02-486 Varşovia, Polonia
4	Pagina web (daca este disponibila)	
5	State membre UE unde produsul este comercializat	Toate statele membre UE
6	Sistemul calitatii	
	- Standard aplicat	Directiva 93/42/CEE
	- Activitati acoperite de standard	EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-2-24:2015, EN 60601-1-8:2007/a1:2013, EN 62304:2006+AC:2008, EN 62366:2008, EN 1789:2007+A2:2014, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 14971:2012, N ISO 15223-1:2012
	- Organismul de certificare	EMKI
7	Declaratie sau autorizatie:	Declaratie DZCE 205
	- Numele semnatarului	Maciej Grabowski
	- Pozitia in compania producatoare	Presedinte al Consiliului de Administratie al Medima Sp. z.o.o
	- Contact (telefon/fax/e-mail)	

Data completarii 03.04.2020

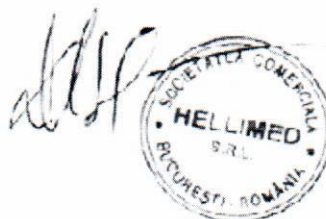Ofertant,
SC HELLIMED SRL,
ADMINISTRATOR
Ec. IONASCU DOINA

1 DESCRIERE DISPOZITIV

Tastatura alfanumerica



Atentie!

Se recomandă reglarea volumului de notificare acustică în funcție de condițiile de aplicare. Setarea prea scăzută a volumului poate duce la omiterea unei posibile pericole de sănătate sau de viață a pacientului.

13.4 Sistem de alarmare

Pompa este echipată cu interfață care permite conectarea la sistemul de apelare al spitalului. Pentru o conexiune corectă, se recomandă utilizarea cablului CAL-01 (vezi secțiunea 24).

Notificarea sistemului de alarmare în spital este generată în timp mai mic de 1s începând cu activarea alarmei.



Atentie!

În nici un caz pompa nu detectează dizabilitatea conexiunii la sistemul de alarmare în spital și nu garantează credibilitatea transmisiei de informații a alarmei.

Conexiunea poate fi verificată prin activarea alarmei de testare prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului  timp de cel puțin 5 secunde (până când se va declanșa alarma de testare). Pentru descrierea pinului soclu, vezi secțiunea 17.1.

13.5 List of alarms and reminders displayed by the pump

13.5.1 High importance alarms

Mesajul	Posibile condiții de activare a alarmei	Recomandări contrare	Configuratie*
Autoinfuzare	Poate sa apara cand: - Subpresiune ridicată în linia pacientului; - seringa este scoasă din pompă; - pistoanele de prindere nu au reușit să prindă bine pistonul seringii în timpul instalării seringilor.	Verificați montarea seringii și linia de extensie.	
Cadere rapida a presiunii	Deconectarea sau deteriorarea pacientului.		Da
Doza terminata	A fost administrată doza programată.		Da
Ocluzia	Creșterea presiunii în linia pacientului peste nivelul definit	Verificați îndepărtarea motivului pacientului și a ocluziei.	Da

Mesajul	Posibile condiții de activare a alarmei	Recomandări contrare	Configuratie*
Infuzie prea lunga	Alarmă apare atunci când: - timpul de perfuzie de sinteză depășește 200 de ore. - volumul dozei sumare depășește 20 l. - numărul de jurnale înregistrate în timpul perfuziei a depășit 64000.	Setarea nouă a perfuziei sau oprirea pompei.	
Verificarea seringii	- Tastele de miscare care detectează poziția seringii nu au fost presate corespunzător. - Scăderea dimensiunii seringii a fost detectată după acceptarea acesteia.	Corectarea poziției seringii în reinstalarea pompei sau a seringii.	
Fara siringa	Siringa nu a fost instalată în pompă în timp ce perfuzia a fost deja programată.	Instalația seringii sau oprirea pompei.	
Siringa goala	Alarma apare atunci cand: - a fost atins un volum minim de lichid definit în seringă (diferită în funcție de mărimea seringii) - siringa a fost complet epuizată.	Instalația seringii sau oprirea pompei.	
Baterie goala	Încărcarea completă a bateriei. Dacă alimentarea externă nu este restabilită, după 3 minute, alarma și pompa se vor opri.	- Conectarea sursei externe de încărcare. - Este recomandată descărcarea completă a bateriei.	

Resetare externă A aparut o conditie de resetare externa Dacă alarma se repetă, contactați service-ul

Resetare nereusita S-a produs resetarea software neașteptată Dacă alarma se repetă, contactați service-ul

*parametrii care pot fi setați în funcție de valoare sau de apariție în setările de configurare. Software-ul Medima Configurator permite modificarea setărilor configurației pompei.

13.5.2 Avertizări de importanță medie

Mesajul	Posibile condiții de activare a alarmei	Recomandări contrare	Configuratie*
Presiune ridicata	Începutul ocluziei. Presiunea a depășit parametrul de ocluzie a prealarmului (valoarea procentuală de ocluzie stabilită în Configuratorul Medima).	- Verificați linia pacientului - Nivelul de ocluzie se schimbă pe cel superior (dacă este sigur pentru un pacient).	Da
Presiune in linie	Începutul ocluziei. Scăderea fluxului de lichid cauzată de răsucirea sau înfundarea liniei pacientului.	- Verificați linia pacientului - Nivelul de ocluzie se schimbă în unul mai mare (dacă este sigur pentru un pacient).	

(Timp) pentru a termina doza	Doza programată se apropie (timpul afișat este calculat pentru epuizarea seringilor). "Timpul de setare a prealarmei poate fi configurat în software-ul Medima Configurator în intervalul 0 - 30min.	Dacă se continuă tratamentul, se începe o nouă perfuzie.	Da
(Timp) pentru a evacua seringă.	Depleția seringilor se apropie (timpul de afișare este calculat la epuizarea seringilor). "Timpul de setare a prealarmei poate fi configurat în software-ul Medima Configurator în intervalul 0 - 30min.	Dacă se continuă tratamentul, se începe o nouă perfuzie.	Da
Baterie scăzută	Nivelul de încărcare a acumulatorului a scăzut sub 15%, fără conectarea la sursa de alimentare externă.	Conexiune de alimentare externă. Dacă mesajul "baterie scăzută" continuă să fie sub formă de memento, contactați serviciul.	
Nu există nicio rețea	Sursa sursei externe de alimentare a pompei a fost deconectată sau oprită.	Verificați sursa de alimentare externă. Dacă a fost conectată sursa de alimentare externă, însă alarma se repetă, contactați serviciul.	
Fixarea incorectă în stația de andocare	Incorectă instalare a pompei în stația de andocare.	Corectarea instalării pompei în stația de andocare sau instalarea pompei în stația de andocare.	

* parametrii care pot fi setați în funcție de valoare sau de apariție în setările de configurare. Software-ul Medima Configurator permite modificarea setărilor configurației pompei.

13.5.3 Analize de importanță redusă

Message	Posibile condiții de activare a alarmei	Recomandări contrare	Configuratie*
Nicio activitate de utilizator	Aceasta se întâmplă la fiecare 2 minute când pompa pornită este lăsată fără activitate de utilizator.	- Se începe perfuzia; - Începutul funcției de așteptare; - Opriti pompa	
Medicamentul nu este activ	Activitatea medicatiei a expirat.	- Trebuie instalată seringă cu un medicament nou. - Alarma va fi ștersa automat când seringă este eliberată de pompă.	Da
Sfârșitul regimului de așteptare	Timpul de așteptare a trecut.	Restartarea infuziei.	Da
Tensiunea de alimentare este prea scăzută	Sursa externă de alimentare conectată permite acum funcționarea corectă a pompei (pompa utilizează parțial bateria).	- Verificați parametrii alimentării externe. - Dacă alarma se repetă, contactați serviciu-ul.	

* parametrii care pot fi setați în funcție de valoare sau de apariție în setările de configurare. Software-ul Medima Configurator permite modificarea setărilor configurației pompei.

13.5.4 Attentionari

Mesajul	Posibile condiții de activare a alarmei	Recomandări contrare	Notificarea liniei de titlu **
Presiune in linie	Presiunea din linia pacientului a depășit nivelul de ocluzie procentuală definit în software-ul Medima Configurator.	- Eliminarea motivului de ocluzie în rândul pacientului. - Deconectati linia pacientului. - Nivelul de ocluzie se schimbă pe cel superior (dacă este sigur pentru un pacient).	
Seringa aproape goala	Pompa aminteste de epuizarea inelului de intrare.	O nouă perfuzie poate fi pornită sau ~~pompa poate fi pornită.~~	Da
Doza aproape terminata	Sfarsitul infuziei este inchis.		Da
Terminarea dozei	A fost administrata doza programată.	O nouă perfuzie poate fi pornită sau pompa poate fi oprită.	Da
Sfarsitul KVO	Are loc atunci când se termină administrarea KVO.	O nouă perfuzie poate fi pornită sau pompa poate fi oprită.	Da
Medicamentul nu este activ	Mai mult timp a trecut de la instalarea seringii în pompă decât timpul definit al activității medicamentului.	- Infusion finish. - New syringe installation - Turning off the pump.	Da
Tensiunea de alimentare este prea scăzută	Sursa externă de alimentare conectată consumă prea puțină energie. Pompa utilizează parțial baterii.	Conexiune de alimentare externă. Dacă memento-ul se repetă, contactați-l cu service-ul.	

Mesaj	Posibilă activare a alarmelor	Interventii recomandate	Linia de titlu notificare**
Fara alimentare	Fara alimentare externa. Pompa functioneaza pe baterie.	Conexiune alimentare externa. Daca alarma se repeata dupa ce s-a conectat sursa de alimentare externa atunci contactati service-ul. Pompa nu poate fi folosit.	
Baterie descărcată	Fara sursa de alimentare externa conectata. Nivel incarcare baterie sub 5%.	Conexiune alimentare externa.	Da
Baterie goala	Bateria este aproape de descarcare complete. In mai putin de 3 minute pompa se va inchide. Fara sursa de alimentare conectata.	Conexiune alimentare externa. Se va inchide atunci cand nivelul bateriei va fi sub 5%. Incarcati pompa pentru infuzie.	Da
Recomandare test baterie	Starea bateriei necunoscută după schimb. Timpul recomandat de testare a bateriei a trecut.	Începeți testarea bateriei. Pompa poate fi folosită pentru perfuzie, dar riscul de rupere a infuziei există o sursă externă de alimentare deconectată.	
Test baterie	Testul bateriei ruleaza. Timpul pana la finalizarea testului este afisat.	Nu este permisă deconectarea pompei de la sursa de alimentare externă.	Da
Defectiune baterie	Memento este generat atunci când au apărut următoarele motive: ▪ deconectarea cablului bateriei sau deteriorarea acestuia ▪ deteriorarea controlerului bateriei ▪ a fost depășită temperatura acceptată a bateriei (supraîncălzire).	Contactati service-ul. Infuzia poate fi pornită, dar pompa poate fi alimentată numai de la sursa de alimentare externă.	Da
Recomandare înlocuire baterie	Baterie deteriorată sau folosită.	Contactati service-ul. Bateria trebuie înlocuită cu una nouă. Infuzia este permisă să fie pornită. Pompa poate funcționa pe baza bateriei într-un interval limitat.	
Deconectați rețeaua!	Deteriorarea pompei. Numărul de defectiune afișat informează despre tipul de avarie.	Sursa de alimentare externă trebuie deconectată de la pompă deodată! Contactati service-ul Pompa nu poate fi utilizata.	

Mesaj	Posibilă activare a alarmelor	Intervenții recomandate	Linia de titlu notificare**
Deconectare baterie!	Deteriorarea pompei. Numărul de defecțiune afișat informează despre tipul de avarie.	Bateria trebuie să fie deconectată cât mai curând posibil. Contactați service-ul. Pompa nu poate fi utilizată.	
Data și ora nu sunt setate	Data și ora nu sunt setate.	Data și ora trebuie setate (vezi secțiunea 12.2) Infuzia poate fi pornită.	
Recomandare service	Verificarea service se apropie sau a trecut.	Pompa trebuie să ajungă în service pentru o verificare. Infuzia poate începe.	
Recomandare reparare	Pompa afișează un număr de eroare legat de o problemă tehnică internă.	Contactați service-ul. Infuzia poate începe.	
Datele din biblioteca de medicamente sunt corupte	Instalarea bibliotecii medicamentelor nu a reușit.	Biblioteca de medicamente trebuie să fie încărcată din nou.	
Configurația utilizatorului este coruptă	A fost detectată o eroare de configurare a utilizatorului.	Verificați dacă setările pompei sunt corecte. Infuzia poate fi pornită.	

** memento-uri sunt afișate în linia de titlu a pompei.

13.5.5 Defecțiuni

În cazul afișării mesajului „Defecțiune XXX sau Eroare XXX” pompa poate fi restartată (oprit și pornit). Dacă mesajul este afișat din nou sau afișat permanent, pompa trebuie examinată de către personalul de service calificat.

În cazul în care există neclarități, contactați direct un reprezentant autorizat Medima.

Dispozitivul deteriorat trebuie protejat de o eventuală utilizare accidentală.

19 TECHNICAL

Debitul	0.01–2000 ml/h for 50 ml/seringa 0.01–1400 ml/h for 30 ml/seringa 0.01–1000 ml/h for 20 ml/seringa 0.01–600 ml/h for 10 ml/seringa 0.01–400 ml/h for 5 ml/seringa 0.01–200 ml/h for 2 ml/seringa Cresteri: 0.01 ml/h from 0.1 ml/h to 99.99 ml/h 0.1 ml/h from 100ml/h to 999.9 ml/h 1 ml/h from 1000 ml/h.
Volumul Infuziei	0.1 – 20 000 ml Cresteri: 0.01 ml pentru doza de la 0.1 ml la 999.99 ml 0.1ml pentru doza de la 1000 ml la 20000 ml.
Timpul Infuziei	1 min-200 ore
Bolus	Bolus automat și manual. Rata: - max.: 2000 ml/h (Depinde de volumul injectomatului) Cresteri: 0.01 ml/h de la 0.1 ml/h la 99.99 ml/h 0.1 ml/h de la 100ml/h la 999.9 ml/h 1 ml/h peste 1000 ml/h Volumul bolusului: 0.1 - 50 ml (Depinde de volumul injectomatului) Cresteri: 0.01 ml de la 0.1 ml peste volumul injectomatului Volum programabil (doză) și timp sau debit.
KVO (KOR)	0.1 – 5.0 ml/h, dar nu mai mare decât debitul Cresteri: 0.1 ml/h Daca KVO este limitat de debitul de infuzie, atunci creșterea este 0.01 ml/h



Priming	Rata: - Programabil: 500 – 2000 ml/h - Mod implicit: 1000 ml/h (rata de primire a liniei depinde de volumul programat al seringii și nu poate fi mai mare decât debitul maxim posibil pentru un anumit tip de seringă) Volumul: max. 5 ml; alarmele de presiune sunt active în timpul primingului																																																																					
Nivelul presiunii de ocluzie	12 nivele: 10 ÷ 120 kPa (75 ÷ 900mmHg, 0.1 ÷ 1.2 bar, 1,45 ÷ 17,40 PSI) Precizia măsurării presiunii: ±15%, dar nu mai mica de 10 kPa (75 mmHg, 0.1 bar, 1.45 PSI) <table><tr><th rowspan="2">Nivelul de ocluzie</th><th colspan="4">Presiunea de ocluzie</th></tr><tr><th>kPa</th><th>mmHg</th><th>bar</th><th>PSI</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>75</td><td>0,10</td><td>1,45</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td><td>150</td><td>0,20</td><td>2,90</td></tr><tr><td>3</td><td>30</td><td>225</td><td>0,30</td><td>4,35</td></tr><tr><td>4</td><td>40</td><td>300</td><td>0,40</td><td>5,80</td></tr><tr><td>5</td><td>50</td><td>375</td><td>0,50</td><td>7,25</td></tr><tr><td>6</td><td>60</td><td>450</td><td>0,60</td><td>8,70</td></tr><tr><td>7</td><td>70</td><td>525</td><td>0,70</td><td>10,15</td></tr><tr><td>8</td><td>80</td><td>600</td><td>0,80</td><td>11,60</td></tr><tr><td>9</td><td>90</td><td>675</td><td>0,90</td><td>13,05</td></tr><tr><td>10</td><td>100</td><td>750</td><td>1,00</td><td>14,50</td></tr><tr><td>11</td><td>110</td><td>825</td><td>1,10</td><td>15,95</td></tr><tr><td>12</td><td>120</td><td>900</td><td>1,20</td><td>17,40</td></tr></table> Reducere automata a ocluziei bolusului. Prezentarea grafică a presiunii perfuziei și a nivelului setat (pictograme).	Nivelul de ocluzie	Presiunea de ocluzie				kPa	mmHg	bar	PSI	1	10	75	0,10	1,45	2	20	150	0,20	2,90	3	30	225	0,30	4,35	4	40	300	0,40	5,80	5	50	375	0,50	7,25	6	60	450	0,60	8,70	7	70	525	0,70	10,15	8	80	600	0,80	11,60	9	90	675	0,90	13,05	10	100	750	1,00	14,50	11	110	825	1,10	15,95	12	120	900	1,20	17,40
Nivelul de ocluzie	Presiunea de ocluzie																																																																					
	kPa	mmHg	bar	PSI																																																																		
1	10	75	0,10	1,45																																																																		
2	20	150	0,20	2,90																																																																		
3	30	225	0,30	4,35																																																																		
4	40	300	0,40	5,80																																																																		
5	50	375	0,50	7,25																																																																		
6	60	450	0,60	8,70																																																																		
7	70	525	0,70	10,15																																																																		
8	80	600	0,80	11,60																																																																		
9	90	675	0,90	13,05																																																																		
10	100	750	1,00	14,50																																																																		
11	110	825	1,10	15,95																																																																		
12	120	900	1,20	17,40																																																																		
Timpul pre-alarmei	Programabil: 1 – 30 min sau nesetat (blocarea pre-alarmei).																																																																					
Precizia debitului conform cu EN60601-2-24	- Precizie tehnica: ± 0.1 % - Precizia infuziei totale luând în considerare o seringă: ± 2% - Precizia debitului depinde de calitatea seringii.																																																																					
Volumul maxim infuzat în timpul unei singure defecțiuni	0.5 ml pentru debit de 2000 ml/h 0.2 ml pentru debit sub 500 ml/h 0.1 ml pentru debit sub 100 ml/h																																																																					
Acumulator	- Ni-MH capacitatea bateriei : 2000 mAh - Timp de functionare: 30 hours @ 5 ml/h - Timp de incarcare completa: ≤ 5 ore																																																																					
Timpul stocării datelor în memorie	Min. 5 ani dupa deconectarea acumulatorului.																																																																					
Siguranta	T 0.5 A / 250 V AC																																																																					

Teaca	
▪ Material	ABS PC
▪ Clasa protectie	IP22 conform cu EN60529
Dimensiuni	364 x 115 x 165 (W x H x D) – excluding pole clamp
Greutate	≤ 2.3 kg Fara cablare
Capacitatea jurnalului de evenimente	Min. 2000 infuzii tipice
Acumulator	
▪ AC	100 (15%) ÷ 240 (+10%) V AC, 50/60 Hz, max. 20VA
▪	12.4 ÷ 15.5 V DC, max. 1A
Porturi de comunicare	RS232, rata de transmisie 115kbit/s Conector optic pentru a comunica cu stația de andocare
Clasificare	Tip CF, rezistenta defibrilator, clasa II, IP22
Conditii de operare	+5°C ÷ +40°C, umidificare max. 90%
Conditii de transport	-20°C ÷ 50°C, umidificare max. 95%
Respectă standardele de siguranță	EN 60601 1, EN 60601 1 2, EN 60601 1-8, EN 60601-2-24, EN 1789, MDD93/42/EEC IIb
Biblioteca de medicamente	▪ Pana la 40 CCA (Clinical Care Area, unitati de administrare); ▪ Pana la 40 categorii in CCA (în funcție de medicamentele distribuite); ▪ Pana la 500 medicamente intr-o CCA; ▪ Pana la 5000 proceduri de dozare a medicamentelor (protocoale) referitoare la dozare în întreaga bibliotecă; ▪ Pana la 10 predefinite si 1 concentrație definita de utilizator pentru fiecare procedură de dozare a medicamentului; ▪ Limite soft și hard, limite max. și min. pentru parametrii care ar putea influența siguranța perfuziei; ▪ Titrare cu limite soft și hard; ▪ Limite aditionale pentru CCA, ▪ Note explicative privind procedurile de dozare a medicamentelor, ▪ Proceduri uniforme pentru seringi și pompe volumetrice ▪ Posibilitatea de marcare a procedurilor pentru toate tipurile de pompe specificate (injectomat, volumetric, PCA/PCEA, TCI/TIVA), ▪ Modul de încărcare a bibliotecilor de medicamente la injectomat este automată prin conectarea la rețeaua LAN fără întreruperea perfuziei (injectomatele trebuie conectate la software-ul MedimaNet).



Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂCătre **Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad,****Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4; Localitate: Arad; Cod Postal: 310037; Tara: Romania**

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnata, **S.C. HELLIMED S.R.L.**, reprezentanți ai ofertantului **S.C. HELLIMED S.R.L.** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **LOT 4 – Injectomat cu baterie** și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentatia de atribuire pentru suma de **299.750,00 RON (douasutenouazecisinouademiisaptesutecincizeci)** platibilă după recepția produselor, la care se adaugă TVA în valoare de **56.952,50 RON (cincizecisisasedemiinouasutecincizecisisidoideleisicincizecibani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm **LOT 4 – Injectomat cu baterie** și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentatia de atribuire în termenul de livrare impus prin documentația de atribuire respectiv **maxim 60 zile de la data transmiterii comenzii de la achizitor catre furnizor**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, (saizeci) respectiv până la data de **06.06.2020** și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.


☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data **06/ 04/ 2020***Ec. IONASCU DOINA,*

în calitate de **Administrator** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.C. HELLIMED S.R.L.**

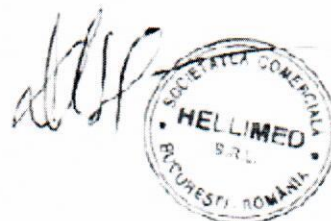



HELLIMED SRL

Tudor Vianu nr. 5-7, district 1, 011635 - Bucuresti
Tel: +4021-224.67.14; Fax: +4021-665 27 01 ;
Mobil: +40730.072.278
Email: office@hellimed.ro . www.hellimed.ro

HELLIMED

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr. crt	Denumire	Model ofertat / Producator	UM	Cantitate	Pret unitar la destinatia finala lei fara TVA	Pret total la destinatia finala lei fara TVA	Taxa pe valoarea adaugata
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=7*19%
1	Lot 4 - Injectomat cu baterie	S300 / Medima	buc	50	5995,00	299.750,00	56.952.50

Ofertant,
SC HELLIMED SRL
DIRECTOR GENERAL
Ec. IONASCU DOINA

