

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, Romania

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
Info@BCR: 0800.801.227, apelabil gratuit din orice
retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif
normal

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-
PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 36175

Inregistrata la Registrul de Evidenta a Preturilor de
date cu caracter personal suprafata 3776 si 3777
Capital Social: 1.625.341.625 RON
SUIE: RNCB DBU
Computerul meu
2020.05.27 11:51

Florina
Iustina
Ionescu

Vedere de ansamblu

Ordin simplu / Plati interne Romania

Client	Referinta	Executie	Semnaturi	Stare
A0375529	20032612553151	26.03.2020	1	Transmis

Modificari ordin

	Utilizator	Data	Ora
Data inregistrarii	7552902	26.03.2020	12:55
Ultima modificare	7552902	26.03.2020	12:55
1. Semnatura	7552901	26.03.2020	16:24

Ordin

Platitor			
Date platitor	CUI/CNP	IBAN platitor	
BTL ROMANIA APARATURTA MEDICALA SRL STR. CPT M. VASILESCU, NR. 12-14 BUCURESTI	9731314	RO48RNCB0090000506460001	

Detalii			
Tip ordin	Suma / Valuta	Numar ordin	
Buget	1.450,00 RON	297	
Detalii		NEP / ANAF	
GARANTIE PART LIC LOT NR 5			

Beneficiar			
Nume beneficiar		CUI / CNP	
SPIT CL JUD DE URG ARAD		3519879	
Cont beneficiar	Nume banca beneficiar	Sucursala banca beneficiar	
RO26TREZ0215006XXX016233	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	ROMANIA	



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:42:00 GMT +2:00 / 27.03.2020 / / Pagina 1


**DECLARAȚIE**

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, Bogdan Gliga reprezentant împuternicit al. SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL, în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului **“Achiziționare echipamente medicale (6 loturi) Numar de referinta: 3519879_2020_PAAPD1135382”, cod CPV 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)**, organizata de **Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad**, din data de 30.03.2020, declar pe proprie răspundere, că:

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98/2016 cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad dupa cum urmeaza:

1	Duna Flaviu	Inginer/ Presedinte fara drept de vot Comisie de evaluare
2	Voinitchi Alina	Inginer/ Membru comisie de evaluare
3	Buzatu Cerasela	Medic primar/ Membru comisie de evaluare
4	Gulyas Albu Mihaela	Medic primar/ Membru comisie de evaluare
5	Nicolescu Cristian	Medic primar Sef Sectie ATI/ Membru supleant comisie de evaluare
6	Crisan Adrian	Medic primar/ Membru supleant Comisie de evaluare
7	Claudiu Coseri	Inginer/ Membru supleant Comisie de evaluare
8	Carmen Alina Lucuta	Manager
9	Mircea Onel	Director medical
10	Florina Ionescu	Sef Serviciu Financiar Contabil
11	Emilia Otilia Popa	Director ingrijiri medicale
12	Daniel Kurunczi	Director Directia Patrimoniu si Achizitii Publice
13	Simona Virciu	Consilier Juridic
14	Gyorgy Boloni, Petru Mot, Mircea Purcaru, Ioan Gligor, Cornel Lucaci, Adrian Tole, Doru Bozga, Cristian Urzica, Daniel Trifon, Cristian Feies, Florin Remetan, Ciprian Manguci, Simona Stan, Vasile Ciceac, Camelia Craivan, Corina Crisan, Petru Padurean, Cristian Salasan, Ion Ulici, Vasile Mosneag, Adrian Butunoi, Iosif Retter, Gheorghe Sabau, Marius Sulincean, Alin Pop, Daniel Durus, Ioan Plaveti, Garofita Popa, Tamas Carol Pero	Consilieri judeteni
15	Cionca-Arghir Iustin-Marinel	Presedinte Consiliu Judetean Arad



Romania

16	Bilcea Ovidiu Sergiu	Vicepresedinte Consiliu Judetean Arad
17	Razvan Olimpiu Cadar	Vicepresedinte Consiliu Judetean Arad
18	Andrei Ando	Director executiv Consiliu Judetean Arad
19	Razvan Ioan Ciubotaru	Director executiv Consiliu Judetean Arad
20	Cristian Cirlugea	Director executiv Consiliu Judetean Arad
21	Gabriela Chiriceu	Director executiv Consiliu Judetean Arad
22	Gheorghina Ribovici	Director executiv Consiliu Judetean Arad
23	Liliana Turjuc	Director executiv adjunct Consiliu Judetean Arad

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data: 26/03/2020

Bogdan Gliga, _____, în calitate de reprezentant imputernicit, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL.





**DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR
REFERITOARE LA CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIA MUNCII**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și ne angajăm să respectăm aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, respectiv din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în România.

Data: 26/03/2020

Bogdan Gliga, _____, în calitate de reprezentant împuternicit, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL.





Zentrum für Qualitätssicherung
 im Gesundheitswesen
 bei Arzneimittel- und
 Medizinprodukteherstellern
 ZUG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
 Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
 (Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 101259 0002 Rev. 00

Manufacturer:

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
 56068 Koblenz
 GERMANY

Facility(ies):

aXcent medical GmbH
 Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANY

Product Category(ies): Medical device for patient monitoring

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

713139671

Valid from:

2018-12-10

Valid until:

2023-12-09

Date,

2018-12-10

Stefan Preiß



Traducere din limba engleză

Sigla ZLG
ZLG-BS-244.10.08

Cod de bare QR

Sigla TÜV SÜD
Product Service

Certificat CE

Sistemul Complet de Asigurare a Calității

Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (MDD), Anexa II, cu excepția secțiunii (4)

(Dispozitive din clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G1 101259 0002 Rev. 00

Producătorul:

aXcent medical GmbH
Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANIA

Facilitatea/Facilitățile:

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANIA

Categoria de produse:

Dispozitiv medical pentru monitorizarea pacientului

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul menționat anterior a implementat un sistem de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a respectivelor dispozitive/categorii de dispozitive în conformitate cu Anexa II MDD. Acest sistem de asigurare a calității se conformează cerințelor prezentei Directive și se supune supravegherii periodice. Pentru comercializarea dispozitivelor de clasa a III-a este obligatoriu un certificat suplimentar din Anexa II (4). A se vedea și notele de pe verso.

Raport nr.:

713139671

Valabil de la:

2018-12-10

Până la:

2023-12-09

Semnătură indescifrabilă
Stefan Preiß

Data: 2018-12-10

Pagina 1 din 1

TÜV SÜD Product Service GmbH este un Organism Notificat înregistrat sub nr. 0123

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organismul de Certificare • Ridlerstrasse 65 • 80339 Munich •
Germania



Product Service

Certificate

No. Q5 101259 0001 Rev. 00

Holder of Certificate: aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANY

Facility(ies):

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANY

Certification Mark:



Scope of Certificate:

Design and development, production, service and distribution of patient monitors as well as sales and distribution of patient monitors, anesthetics and ventilators

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 713139671

Valid from: 2018-12-10

Valid until: 2021-12-09

Date, 2018-12-10

I. Preiß

Stefan Preiß



Traducere din limba engleză

Sigla DAkKS
Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

Cod de bare QR

Sigla TÜV SÜD

Certificat

Nr. Q5 101259 0001 Rev. 00

Deținătorul Certificatului:

aXcent medical GmbH
Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANIA

Facilitatea/Facilitățile:

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANIA

Marca de Certificare:



Domeniul de aplicare al Certificatului:

Proiectarea și dezvoltarea, producția, distribuirea și asigurarea serviciilor de reparații pentru monitoare pentru pacient, precum și vânzarea și distribuirea de monitoare pentru pacient, aparate de anestezie și ventilatoare

Standardele aplicate:

EN ISO 13485: 2016
Dispozitive medicale - Sistemele de management a calității –
Cerințe în scopuri de reglementare
(ISO 13485: 2016)
DIN EN ISO 13485: 2016

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH certifică faptul că societatea mai sus-menționată a implementat și menține un sistem de management al calității care îndeplinește cerințele standardului (standardelor) enumerat(-e). A se vedea și notele de pe verso.

Raport nr.: 713139671
Valabil de la: 2018-12-10
Până la: 2021-12-09

Semnătură indescifrabilă
Stefan Preiß

Data: 2018-12-10

Pagina 1 din 1

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstrasse 65 • 80339 Munich • TÜV®
Germania

Subsemnata, Masgras Lavinia, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în limba engleză care a fost vizat de mine, traducător autorizat în baza autorizației nr. 22170.

Traducător autorizat: Masgras Lavinia



Propunere Tehnica Lot nr. 5

Echipament: Ventilator de transport

Cant.: 3 buc.

Denumire: Musca x2

Produsator/Tara: aXcent Medical/ Germania

An fabricatie: 2020



CARACTERISTICI TEHNICE	DA	NU	CONFORMITATE
Sa asigure suport vital pentru pacientii cu insuficienta respiratorie acuta pe parcursul transportului	X		Conform brosură aXcent MUSCA x2
Circuite cu o singura scurgere, o singura supapa si circuite cu doua membre, precum si interfete multiple pentru pacienti	X		Conform brosură aXcent MUSCA x2
Sa poata fi utilizat pentru o gama larga de tipuri de pacienti – adulti, copii, pacienti cu insuficienta respiratorie acuta protezata mecanic	X		Conform fisa de date MUSCA X2, vezi „moduri de ventilatie,, si „volume”
Oxygen suplimentar pentru pacientii care necesita terapie cu oxigen	X		Conform fisa de date MUSCA X2, vezi „Concentratie O2”
Sa permita debitari de pana la 30 L pentru FiO2 livrat pana la 95%	X		Superior, conform fisa de date MUSCA X2, vezi „Volum manual”
Sa poata fi progrmate pragurile de minim si maxim de inspiratie	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Asigura suport vital pentru pacientii cu o greutate mai mare de 5 kg	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Circuite: 1 circuit de scurgere, 1 circuit cu supapa, 1 circuit dublu	X		Conform brosură aXcent MUSCA x2
Moduri de terapie: CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS, P(A)C, rspratie manuala	X		Conform brosură aXcent MUSCA x2
Ventilatie apnee: Volum si presiune	X		Conform fisa de date MUSCA X2



Volum Tidal livrat (cm H ₂ O): adulti 100 – 250 ml, copii 50 – 300 ml	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Rata respiratorie: Adult: Oprit, 2 – 50 bpm, Pediatrie, Oprit, 5 – 80 bpm	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Date monitorizate: FiO ₂ , afisare pe acrn in timp reala, Presiune si Flux (25 Hz) si Trend pentru 10 zile	X		Conform fisa de date MUSCA X2, si Brosura MUSCA x2
Alarmer : FiO ₂ si SpO ₂ atunci cand sunt conectare	X		Conform Brosura MUSCA X2
Greutate aparat < 5 Kg	X		Conform Brosura MUSCA X2
Baterie interna litiu-ion	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Timp de utilizare continua > 6 ore	X		Conform fisa de date MUSCA X2
Nivel acustic: 43 +/- 3 dBA	X		Conform fisa de date MUSCA X2, nivel acustic reglabil.
SERVICE IN GARANTIE			
Durata - min. 24 luni de la data receptiei finale;	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
Timp maxim de interventie - max. 48 ore	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
SERVICE POST GARANTIE			
La cerere, contra cost;	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
timp maxim de inteventie - max. 48 ore	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
TRANSPORT, INSTALARE I PUNERE IN FUNCTIUNE			
Se va realiza gratuit de catre furnizor, aceste servicii fiind incluse in pretul mijlocului fix achizitionat	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
INSTRUIREA GRATUITA			
instruirea personalului medical se va efectua la sediul beneficiarului, in locatia de livrare, minim 2 perioade a cate 2 zile incluse in pret.	X		Conform solicitarii din Cietul de Sarcini
Certificat CE si ISO pentru producator si funizor	X		Atasat



Manual de utilizare în limba română.	X	Conform solicitării din Cîștîl de Sarcini
--------------------------------------	---	--



Data: 26/03/2020

Bogdan Gliga, _____, în calitate de reprezentant împuternicit, legal
autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC BTL Romania Aparatura
Medicala SRL.





Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 101259 0002 Rev. 01

Manufacturer:

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANY

Facility(ies):

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANY

**Product Category(ies): patient monitors, anesthesia devices,
ventilators**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

713154534

Valid from:

2019-09-13

Valid until:

2023-12-09

Date,

2019-09-13

Stefan Preiß

Head of Certification/Notified Body



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 101259 0002 Rev. 01

Manufacturer:

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANY

Facility(ies):

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANY

Product Category(ies): patient monitors, anesthesia devices, ventilators

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

713154534

Valid from:

2019-09-13

Valid until:

2023-12-09

Date,

2019-09-13

Stefan Preiß
Head of Certification/Notified Body

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認證證書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT

Sigla ZLG
ZLG-BS-244.10.08

Cod de bare QR



Traducere din limba engleză

Sigla TÜV SÜD
Product Service

Certificat CE

Sistemul Complet de Asigurare a Calității
Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (MDD), Anexa II, cu excepția secțiunii (4)
(Dispozitive din clasa IIa, IIb sau III)
Nr. G1 101259 0002 Rev. 01

Producătorul:

aXcent medical GmbH
Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
GERMANIA

Facilitatea/Facilitățile:

aXcent medical GmbH
Dr.-Walter-Lessing-Str. 4, 56112 Lahnstein, GERMANIA

Categoria de produse:

**Monitoare pentru pacienți, aparate de anestezie,
ventilatoare**

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul menționat anterior a implementat un sistem de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a respectivelor dispozitive/categorii de dispozitive în conformitate cu Anexa II MDD. Acest sistem de asigurare a calității se conformează cerințelor prezentei Directive și se supune supravegherii periodice. Pentru comercializarea dispozitivelor de clasa a III-a este obligatoriu un certificat suplimentar din Anexa II (4). A se vedea și notele de pe verso.

Raport nr.:

713154534

Valabil de la:

2019-09-13

Până la:

2023-12-09

Semnătură indescifrabilă
Stefan Preiß

Data: 2019-09-13

Pagina 1 din 1

TÜV SÜD Product Service GmbH este un Organism Notificat înregistrat sub nr. 0123

TÜV®

TÜV SÜD Product Service GmbH • Organismul de Certificare • Ridlerstrasse 65 • 80339 Munich •
Germania

Subsemnata, Masgras Lavinia, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în limba engleză care a fost vizat de mine, traducător autorizat în baza autorizației nr. 22170.

Traducător autorizat: Masgras Lavinia



MUSCA X2 Data sheet

Dimensiuni L×H×B in mm(include connectors)	250×200×127mm
Greutate	2.37 kg
Display	Monitor de 7" TFT Resolutie 800 x 480 pixels
Timp de operare	6 ore
Timp de incarcare	6 ore
Control	Control volum; control presiune
Moduri ventilatie	Control volum: V-AC, V-SIMV, IPPV Control presiune: P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV alte moduri: CPR
Concentratie O₂	40% sau 100%
Volum manual	1 ~ 80 L/min cu 100% FiO ₂ 1 ~ 90 L/min c 40u% FiO ₂
Volum tidal (ATPD)	50 ~ 2500 mL (ATPD)
Volum pe minut (MV)	0 ~ 80 L/min
Volum Sigh	De 1.5 pana la 2 ori din volumul tidal
Sigh circle	50 ~ 200
Frecventa ventilatiei	0 ~ 120 bpm
Ratia insp-exp.	9:1 to 1:9
Presiune butelie aer	2.7 to 6.0 bar
Presiune inspiratorie	5 ~ 60 mbar
Presiunea maxima de ventilatie	15 ~ 70 mbar
Mod Trigger	Activare presiune
Presiune Trigger	-20 ~ 20 mbar
Fereastra Trigger	0 ~ 100%
Presiune CPAP	0 ~ 30 mbar PEEP/CPAP
Monitorizare ETCO₂	0 ~ 150 mmHg
Timp apnee	5 ~ 60S
Mosd ventilatie apnee	Apnea Vent (PCV)
Conexiune gaz	Conductor DIN quick
Alimentare	Baterie litiu 7.4V; 10.2Ah
Meniu in limba engleza	

June, 2018

aXcent medical GmbH
 Josef-Görres-Platz 2 – 56068 Koblenz / Germany
 Phone: +49 261 30 11 117 – Fax: +49 261 30 11 111
 eMail: info@aXcentmedical.com – www.aXcentmedical.com



axcent
medical


Intensive Care and Transport Ventilator Solutions



www.axcentmedical.com



MUSCA x1 Portable Ventilator

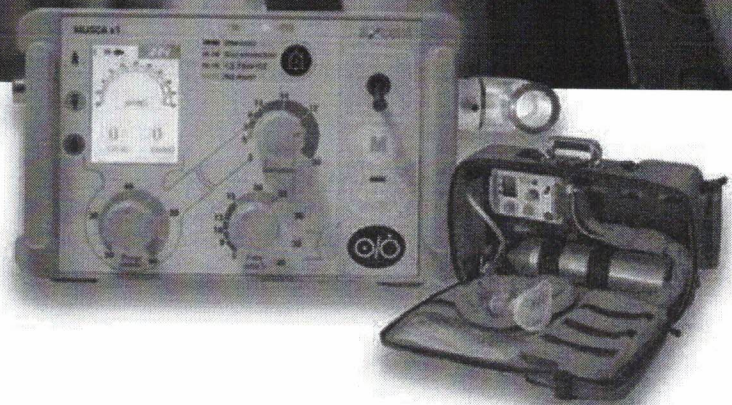

Features

- Portable and easy operation
- Innovative voice-guided direction
- Tidal volume range: 100~1500 ml
- Air Mix option for 60% O₂
- 3 knobs for flexible parameters adjustment
- TFT display of airway pressure and ventilation mode
- 3 ventilation modes. IPPV, Assisted control and Manual control
- Li-ion rechargeable battery with more than 10 hours of working time

www.axcentmedical.com





MUSCA x2

Emergency & Transport Ventilator

Features

- Compact design with weight 3.4 kg
- 7" color touch screen with screen lock function
- Airway pressure and EtCO₂ real-time waveforms
- Smart CPR mode according to AHA guideline
- I:E ratio range: 1:9 to 9:1; and tidal volume range: 50-2500 ml
- 9 ventilation modes: IPPV, V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV, Manual, CPR
- Internal PEEP valve
- 40% or 100% for FiO₂
- Rechargeable Li-ion battery with 6 hours working time
- Optional Mainstream EtCO₂ analyzer
- Audible and visual alarm for multi-parameters
- IPX4 waterproof

axcent
medical





Intensive Care and Transport Ventilator Solutions

For more information, please contact us.

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
Germany

Phone: +49 261 30 11 117

Fax: +49 261 30 11 111

Mail: info@axcentmedical.com

www.axcentmedical.com

AX.VEN.01-04EN - Edition 09.2019



Traducere din limba engleză



axcent
medical

Soluții pentru terapie intensivă și ventilator portabil




www.axcentmedical.com



MUSCA x1

Ventilator portabil

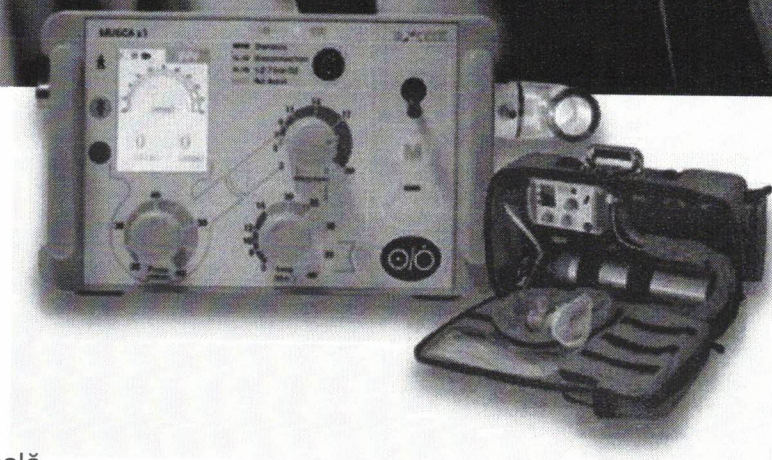

Caracteristici

- Portabil și ușor de utilizat
- Operare inovatoare prin ghidare vocală
- Gama fluxului: 100~1500 ml
- Opțiunea Air Mix pentru 60% O₂
- 3 butoane pentru o ajustare flexibilă a parametrilor
- Display de tip TFT pentru presiunea căilor respiratorii și modul de ventilație
- 3 moduri de ventilație. IPPV, control asistat și control manual
- Acumulator reîncărcabil Li-ion ce asigură peste 10 ore de funcționare

www.axcentmedical.com





MUSCA x2

Ventilator portabil și pentru urgențe

Carateristici

- Design compact, având o greutate de 3,4 kg
- Ecran color de tip touch screen de 7" cu funcție de blocare a ecranului
- Forme de undă în timp real pentru presiunea căilor respiratorii și EtCO₂
- Modul Smart CPR conform ghidului AHA
- Gama de raport I:E: de la 1:9 la 9:1; gama fluxului: 50-2500 ml
- 9 moduri de ventilație: IPPV, V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV, Manual, CPR
- Supapă internă PEEP
- FiO₂ de 40% sau 100%
- Acumulator reîncărcabil Li-ion ce asigură 6 ore de funcționare
- Opțional Analizor Mainstream EtCO₂
- Alarmă sonoră și vizuală pentru mai mulți parametri
- Rezistență la apă IPX4



aXcent
medical



Soluții pentru terapie intensivă și ventilator portabil

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.


aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
Germania

Telefon: +49 261 30 11 117
Fax: +49 261 30 11 111
E-mail: info@axcentmedical.com



www.axcentmedical.com



FORMULAR DE OFERTĂ - Lot 5

Către: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Strada: Str. Andrei Karoly, nr. 2 – 4, Arad, jud. Arad

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **Lot 5 - Ventilator de transport (3 bucati)**, și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentația de atribuire pentru suma de **109500 Lei (o suta noua mii cinci sute Lei)**, platibilă după recepția produselor, la care se adaugă TVA în valoare de **20805 Lei (douazeci de mii opt sute cinci Lei)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm **Lot 5 - Ventilator de transport (3 bucati)** și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentația de atribuire în termenul de livrare impus prin documentația de atribuire respectiv 60 zile (șaizeci zile).

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 130 zile, (o suta treizeci zile) respectiv până la data de 07.08.2020 și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data: 26/03/2020

Bogdan Gliga, _____, în calitate de reprezentant imputernicit, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC BTL Romania Aparatura Medicala SRL.

