



Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Județean
de Urgență Arad, OU=Administrativ,
E=scjaradsecretariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
spital -scjuarad.bap@gmail.com
CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autentificată
Computerul meu
2020.05.22 16:39

Documente negociere nr. 16115

1 mesaj

Raluca CHIRIC (MLM) <raluca.chiric@medicalmall.ro>

30 aprilie 2020, 10:26

Către: scjuarad.bap@gmail.com

Cc: licitatii@medicalmall.ro, cristian.bitu@medicalmall.ro, romeo.manolea@medicalmall.ro

Bună ziua,

Regăsiți atașate documentele aferente lotului 2 (ventilator de transport) din invitația de negociere fără publicarea unui anunț de participare nr. 16115 având ca obiect achiziționare echipamente medicale (3 loturi).

De asemenea, vă rugăm să confirmați primirea mail-ului.

Mulțumim frumos.

O zi bună,

Raluca CHIRIC

Responsabil Licitatii

Mobil: +4 0723 393 133

E-mail: raluca.chiric@medicalmall.ro

www.medicalmall.ro

MEDICAL LOGISTIC MALL S.R.L.

E-mail: office@medicalmall.ro


Tel.: +4 021 311 91 61 / 62

Tel./Fax: +4 021 311 91 63

Str. Valeriu Braniste nr. 60A,

et. 3, Ap.10, Bucuresti

ROMANIA



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

3 ataşamente



Calificare - scan.pdf
1790K



Financiar - Scan.pdf
167K



Tehnic - Scan.pdf
8894K



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese
conform prevederilor art. 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București, în calitate ofertant la INVITATIE PARTICIPARE – Negociere fara publicarea unui anunt de participare nr. 16115/28.04.2020, pentru achiziția de „Achiziționare echipamente medicale (3loturi)” lot 2 Ventilator de transport, la data de 30.04.2020, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență Arad, declar pe proprie răspundere, că:

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea 98/2016 cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad după cum urmează:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția detinuta in cadrul Comisiei de evaluare
1	Duna Flaviu	Inginer/Presedinte cu drept de vot
2	Crisan Adrian	Medic/Membru sau membru de rezerva
3	Pilat Luminita	Biochimist/Membru sau membru de rezerva
4	Vidican Cosmina	Consilierjuridic/Membru sau membru de rezerva
5	Voinitchi Alina	Inginer/Membru sau membru de rezerva
6	Anita Rista	Economist/Membru sau membru de rezerva
7	Carmen Alina Lucuta	Manager
8	Mircea Onel	Director medical/Membru sau membru de rezerva
9	Florina Ionescu	Director Financiar Contabil
10	Emilia Otilia Popa	Director ingrijiri medicale/Membru sau membru de rezerva
11	Daniel Kurunczi	Director Direcția Patrimoniu si Achiziții Publice/ Membru sau membru de rezerva
12	Simona Virciu	Consilier Juridic/Membru sau membru de rezerva



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL
BIȚU Cristian-Florin

Administrator





BRB352KNP

Text suplimentar: 4669-în principal echipamente si aparatură medicală
Data certificatului constatator: 07.05.2019

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019

Nu există înregistrări.

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 15.04.2020

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului CHIRIC RALUCA-ANDREEA, fiindu-i necesar la Licitatie.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Raport generat în data de 15.04.2020 ; 15:55:15

CONFORM CU
ORIGINALUL





BRB352KNP

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Text suplimentar activitate principală: în principal echipamente și aparatură medicală

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Timișoara, Strada CORIOLAN BREDICEANU, Nr. 31B, Ap. 1, Județ Timiș
Act sediu: Act adițional nr. 3 din data 25.06.2018 la contract de închiriere, nr. 1 din data 04.07.2016
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 04.07.2016.
Data expirării dovezii de sediu: 04.07.2020.
Durata sediului: 4 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 573828 din 02.04.2012

Activități desfășurate în afara sediului social și a sedilor secundare (CAEN REV. 2):

- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

Data certificatului constatator: 05.04.2012

Sediul social din: București Sectorul 2, Strada GIUSEPPE GARIBALDI, Nr. 8-10, MEZANIN, CAMERELE 3 ȘI 4

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 262580 din 15.06.2016

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 17.06.2016

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Timișoara, Strada CORIOLAN BREDICEANU, Nr. 31B, Ap. 1, Județ Timiș

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 186774 din 02.04.2019

Activități la sediu:

- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

Raport generat în data de 15.04.2020 : 15:55:15

CONFORM CU
ORIGINALUL





BRB352KNP

Calitate: asociat
Cetățenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data și locul nașterii: 17.04.1975, BRASOV
Sex: feminin
Aport la capital: 1000 LEI
Aport vărsat total: 1000 LEI
Aport vărsat în LEI : 1000 LEI
Număr părți sociale: 100
Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

BIȚU CRISTIAN FLORIN

Calitate: asociat
Cetățenie: română
Data și locul nașterii: 11.10.1979, Loc. Timișoara, Timiș, România
Sex: masculin
Aport la capital: 1000 LEI
Aport vărsat total: 1000 LEI
Aport vărsat în LEI : 1000 LEI
Număr părți sociale: 100
Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

BIȚU CRISTIAN FLORIN

Calitate: administrator
Cetățenie: română
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 11.10.1979, Loc. Timișoara, Timiș, România
Puteri: DEPLINE
Data numirii: 20.04.2015
Durată mandat: nelimitată
Data depunere specimen semnătură: 23.04.2015
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 15.04.2020 : 15:55:15

CONFORM CU
ORIGINALUL



2/4



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



BRB352KNP

Nr.: 214296/15.04.2020

Oficiul
National al
Registrului
Comertului

Digitally signed
by Oficiul
National al
Registrului

CERTIFICAT CONSTATATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 214296 din 15.04.2020, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

Location:
Bucuresti

MEDICAL LOGISTIC MALL SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/20518/2007, atribuit în data de 01.11.2007

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/20518/2007

Cod unic de înregistrare: 22672401

Certificat de înregistrare: B3204295, emis pe data de 17.06.2016 și eliberat la data 21.06.2016

Adresă sediu social: București Sectorul 2, Strada GIUSEPPE GARIBALDI, Nr. 8-10, MEZANIN, CAMERELE 3 ȘI 4

Contacte sediu social: telefon: 0722423727

Contacte firmă: telefon: 0722423727

Actul de înmătrulare și autorizare: Încheiere judecătorească 20204/01.11.2007

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 14.08.2019

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Act aditional nr. 1 din data 04.07.2017 la contract de subînchiriere și anexele la acesta, nr. EMCS 1605314500 din data 31.05.2016

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 31.05.2016.

Data expirării dovezii de sediu: 04.07.2022.

Durata sediului: 6 ani 1 luni 4 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 2000 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 200

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

TUBI ELENA RAMONA

Raport generat în data de 15.04.2020 : 15:55:15

CONFORM CU
ORIGINALUL





MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro


**DECLARAȚIE
PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR
REFERITOARE LA CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI DE PROTECȚIA MUNCII**

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și ne angajăm să respectăm aceste condiții pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, respectiv din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în România.

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL
BIȚU Cristian-Florin
Administrator







MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București, în calitate de ofertant declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL

BIȚU Cristian-Florin

Administrator





MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că, sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016, respectiv:

- n-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL

BIȚU Cristian-Florin

Administrator







MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București, în calitate de ofertant, la procedura INVITATIE PARTICIPARE – Negociere fara publicarea unui anunt de participare nr. 16115/28.04.2020, pentru achiziția de „Achiziționare echipamente medicale (3loturi)” lot 2 Ventilator de transport, la data de 30.04.2020, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență Arad, declar pe propria răspundere că nu sunt în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

ART. 167

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6).

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprie utilizării conform destinației prevăzute în contract.



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro



Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL
BIȚU Cristian-Florin







LOT 2 – Ventilator transport - 3 buc


	Cerinte functionale	Ofertant Astral 150
1	Sa asigure suport vital pentru pacienți cu insuficienta respiratorie acuta pe parcursul transportului.	Brosura Pg. 6, rind 1
2	Circuite cu o singură scurgere, o singură supapă și circuite cu două membre, precum și interfețe multiple pentru pacienți,	Brosura Pg. 6, rind 3,4,5. Manual pg.7(11)
3	Sa poata fi utilizat pentru o gamă largă de tipuri de pacienți - adulți si copii, pacienți cu insuficienta respiratorie acuta protezata mecanic.	Brosura Pg 3,,Manual pg. 7(11)
4	Oxygen suplimentar: Pentru pacienții care necesită terapie cu oxigen,	Manual pg.31(35)
5	Sa permită debitări de până la 30 L/min pentru un FiO2 livrat până la 95%.	Manual pg.31(35)
6	Sa poata fi programat pragurile minim si maxim de inspirație	Brosura Pg. 6
7	Asigura suport vital pentru pacienți cu o greutate > 5Kg	Brosura Pg. 6 ,rind 1
8	Circuite : 1 circuit de scurgere, 1 circuit cu supapa, 1 circuit dublu	Brosura Pg 6, rind 3,4,5. Manual pg.20(24)
9	Moduri de Terapie: CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS, P(A)C,	Brosura Pg. 6, rind 7,8
10	Respirație manuala	Brosura Pg. 6 ,rind 9
11	Ventilație Apnee: Volum si Presiune	Brosura Pg. 6 ,rind 11
12	Volum Tidal livrat (cm H2O) :Adult: 100 - 2500 ml, Copii: 50 până la 300 ml	Brosura Pg. 6 ,rind 15. Manual pg.20(24)
13	Rata respiratorie: Adult: Oprit, 2 la 50 bpm ;Pediatrie: Oprit, 5 la 80 bpm	Brosura Pg. 6, rind 16
14	Date monitorizate : FiO2, afișare pe ecran in timp real Presiune și flux (25 Hz) si trend pentru 10 zile	Brosura Pg 6., rind 118,19,20. Manual pg.14(18)
15	Alarmer : FiO2 și SpO2 atunci când sunt conectate	Brosura Pg. 6, rind 22
16	Greutate aparat: < 5 Kg	Brosura Pg.6, rind 24, Manual pg. 61(65)
17	Baterie interna : litiu-ion;	Brosura Pg. 6, rind 26, Manual pg 61(65)
18	Timp utilizare continua > 6 ore	Brosura Pg. 6, rind 26, Manual pg. 61(65)
19	Nivel acustic : 43 ± 3 dBA	Brosura Pg 6 ,rind 27







Astral™
Enrich life




Astral 100 and 150:
Time to rethink respiratory care

CONFORM CU
ORIGINALUL



ResMed.com/Astral



Versatile life support ventilation

ResMed's Astral™ 100 and Astral™ 150 life support ventilators offer excellence in invasive and noninvasive ventilation without compromise. From initial setup to everyday use, Astral offers greater freedom, confident care, and designed efficiency to enrich life for you and your patients.

- **Greater freedom**

Astral's discreet and lightweight design allows patients to go beyond the confines of the healthcare environment, while delivering real peace of mind to them, their clinicians and caregivers.

- **Confident care**

Astral offers a range of treatment options for both adult and paediatric patients. It is compatible with a variety of patient interfaces and is designed for both invasive and noninvasive applications.

- **Designed efficiency**

With easy setup, simple servicing and an intuitive interface, Astral is designed to make ventilation support straightforward and efficient.



Confident care

Versatile treatment options


Astral delivers excellence in leak and valve ventilation for invasive and noninvasive applications, as well as providing a full suite of therapy modes to suit both adult and paediatric patients.

Simple patient setup

Astral's intuitive interface, presettable programs and setup assistant allow for fast and accurate patient setup. The QuickConnect™ valve circuits have been specifically designed to reduce known and common setup errors so therapy can be delivered quickly and safely.

Easy monitoring

Real-time waveforms and patient information are displayed on the large colour touchscreen to ensure correct setup and to track patient condition. FiO_2 and SpO_2 are integrated to complete the therapy picture.



A full suite of modes offers versatile therapy options as the patient's condition progresses.

Greater freedom

Peace of mind with long battery life

Astral ventilators are designed for patient freedom. The combination of internal and external batteries provides up to 24-hours* run-time. Planning day-to-day activities is easier because Astral has the power to keep going, hour after hour.

Balancing battery capacity with portability

Mobility in its most practical sense requires balancing battery run-time with the weight and portability of the ventilator. At just 3.2 kg with an 8-hour internal battery, patients can now go longer, and travel further, knowing they have the reliability of Astral behind them.

Discreet by design

Contemporary design offers your patients a streamlined, discreet, life support device that sits quietly in the background.

Designed efficiency

Simplifying inventory management

Astral can treat a broad range of respiratory conditions in paediatric and adult patients, so just one device can go a lot further. Fast turnaround times and simple servicing also reduce the need for backup ventilators, saving both time and money.

Saving time during training and patient care

Astral's intuitive interface and easy operation can minimise training time. Easy navigation with user-friendly menus enable quick and confident setup so you and your staff can focus on what's important – the overall care of your patients.


Simple servicing

Easy servicing has been built into Astral. The pneumatic block can be quickly and seamlessly swapped during an in-field service or at the service centre, reducing downtime for the device, and improving cost efficiencies.


* With the 8-hour internal battery and two 8-hour external batteries.

CONFORM CU
ORIGINALUL




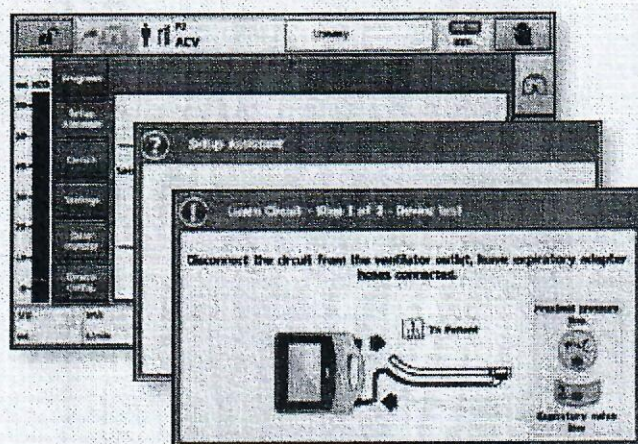

The built-in Learn Circuit feature evaluates and compensates for resistance in the circuit to optimise ventilation and deliver the right pressure and flow at the mask.




Real-time pressure and flow waveforms display essential therapy parameters on the large touchscreen.




Mobility bags

ResMed offers two mobility bags for Astral ventilators – a bag that fits the device and all its essential accessories, and an ultra-light SlimFit bag for the Astral device on its own. Broad, comfortable shoulder straps make the bags easily portable, plus extra straps allow for easy mounting onto wheelchairs.




Hospital Trolley

ResMed's Hospital Trolley has been designed to transport Astral around any hospital or clinical setting. It features the option of a medical grade power strip located in the centre console, which lets you connect multiple electrical devices and power them with just one cord.



Remote Alarm II

ResMed's Remote Alarm II provides the convenience of monitoring alarms from another room, ward or central monitoring station. It offers peace of mind and freedom for caregivers to move away from the patient's bedside without compromising patient safety.



A complete respiratory system

Astral easily connects to the HumiCare™ D900 heated humidifier to reduce the risk of ventilator associated complications and actively condition the air.



ResMed

Ordering information

	Astral 150 – APAC 27083
	Astral 100 – APAC 27081
	HumiCare D900
	Hospital trolley 27914
	Astral mobility bag 27917
	Astral SlimFit mobility bag 27949
	Astral table stand 27915
	External battery 27918
	Remote Alarm II ROW 27902 (does not include cable)
	Single circuit smooth bore 22 mm with QuickConnect
	Oximetry set with reusable soft sensor 22370

Technical Specifications		Astral 100	Astral 150
INDICATIONS FOR USE		Life support for patients over 5 kg	Life support for patients over 5 kg
CIRCUIT			
Single circuit with leak		•	•
Single circuit with valve		•	•
Double circuit			•
THERAPY			
Valve circuit therapy: CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV, PS		•	•
Leak circuit therapy: CPAP, ST, PAC		•	•
Manual breath			•
Sigh breath (recruitment)			•
Apnoea ventilation		Volume and pressure	Volume and pressure
Preset programs		2	4
PRESSURE RANGE AND SETTINGS			
Delivered pressure (cm H ₂ O)		2–50 (leak circuit) 0–50 (valve circuit)	2–50 (leak circuit) 0–50 (valve circuit)
Delivered tidal volume (cm H ₂ O)		Adult: 100 to 2500 mL Paediatric: 50 to 300 mL	Adult: 100 to 2500 mL Paediatric: 50 to 300 mL
Respiratory rate		Adult: Off, 2 to 50 bpm Paediatric: Off, 5 to 80 bpm	Adult: Off, 2 to 50 bpm Paediatric: Off, 5 to 80 bpm
DATA			
SpO ₂ monitoring		Optional	Optional
FiO ₂ monitoring		Optional	•
7 days of high-resolution data with 25Hz pressure and flow		On screen and download	On screen and download
365 days of summary data		On screen and download	On screen and download
ALARMS		A wide range of settable alarms are available including FiO ₂ and SpO ₂ when connected.	
DIMENSIONS			
Weight		3.2 kg	3.2 kg
Dimensions (l x W x H)		285 mm x 215 mm x 93 mm	285 mm x 215 mm x 93 mm
Internal battery		Lithium-Ion battery, 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh, 8 hour run time	Lithium-Ion battery, 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh, 8 hour run time
Sound power level		43 ± 3 dBA*	43 ± 3 dBA*
Sound pressure level		35 ± 3 dBA*	
IEC 60601-1 CLASSIFICATIONS: Medical electrical equipment - general requirements for basic safety and essential performance.		Class II (double insulation) Type BF 8 Continuous operation Suitable for use with oxygen	
* As measured according to IEC60601-2-12:2011			

CONFORM CU ORIGINALUL



Astral features



ResMed Ltd.
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
(for Astral)

ResMed Humidification Technologies GmbH
Kornelstr. 4
72250 Freudenstadt Germany
(for HumiCare D900)

Distributed by: ResMed Ltd, Bella Vista NSW Australia. See ResMed.com for ResMed locations worldwide. Astral, HumiCare and QuickConnect are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. Specifications may change without notice. Product availability may vary across regions. © 2014 ResMed Ltd. 1017716/7 2014-12

A black and white photograph of a dark, textured, dome-shaped object, possibly a piece of equipment or a component, with a rectangular opening on its side. The object is shown from a low angle, emphasizing its rounded form. The surface appears rough or metallic. The rectangular opening is on the right side, showing some internal structure. The background is a light, grainy texture.

Respectivamente, as possibilidades de um governo liberalizador, por meio da introdução de reformas estruturais, e de um governo conservador, de se manter no poder, são avaliadas em termos de (i) a tendência do poder econômico de apoiar o atual governo e (ii) a possibilidade de o mesmo apoiar o governo liberalizador.







[illegible]

	Model 050 27390 Jabón 130 27070 CROCO
	Cuero de cabal 27394
	Punto de rebato 27395
	Punto de rebato, Mata Joven 27340
	Shoe de mata Joven 27316
	Modelo normal 27316
	Mata la rebato y 27342 no rebato cabal
	Shoe rebato y mata 27342 Shoe 22 mm rebato y rebato de rebato 13151
	Shoe de rebato y mata 27316 rebatido

[illegible]

Ventilație pentru susținerea vieții



ReelMed.com/A5tra

CLAUDIU CRIȘAN
Traducător și interpret Autorizat
Limba Engleză / Limba Franceză
Aut. Nr. 30261/2010

When you choose Astral with IntelligentAir, you are not only choosing life support. You are discovering a way to help your patients breathe easier.

Delivering on its promise to provide confident care, greater freedom and designed efficiency, Astal is proving itself to be a leading life support ventilator series for a wide range of patients.

With the introduction of an auto-adjusting volume assurance mode, which includes an intelligent back-up rate and optional auto-adjusting EPAP, Astral 100 and Astral 150 set a new quality standard in personalised and responsive life support ventilation. Together, we call these technologies IntelligentAir.



To keep you informed on patient changes over time, a number of different monitoring tools are at your disposal.

ResScan™: ResMed's patient data management software provides clinicians with a great way to review summary and detailed data, even as their patients receive treatment at home.


Oximetry: Integrated FiO_2 and optional SpO_2 monitors are available.

Real-time waveforms: Pressure and flow curves are quickly accessible on a large colour touch screen, and provides continuous visual on patient trends.

Astral includes features to add greater customisation and peace of mind for more dependent patients.

Alarme: Astral is equipped with a set of fixed and adjustable alarms, categorised by priority, to bring patients and carers to attention when needed. The dedicated disconnection alarm has also been

big button: Included for quick access to start or stop ventilation, as well as to mute alarms. This feature is particularly useful for those with impaired dexterity or weakness.



Monitoring options with state-space models




CONFORM CU
ORIGINALUL

Astral specifications

[illegible]

Product and accessory codes

	Aerial 152		
	Aerial 102		
	Hornet, stand remote controlled, up 1200	27163	
	Aerial cap plate	27166	
	Hornet, used for public use	27148	
			
			
	Aerial mobility bag	27157	
	Aerial Blimp, modular bag	27149	
	Aerial table stand	27115	
	External battery	27116	
	Panic alarm II	27162	
	Alarm not in this table		
	Discovery kit with remote control	27170	
	RaskMed Connectivity Module	27253	



Thyridopteryx is represented by two species of *A. nana*, *A. nana* and *A. nana*. It is also represented by the common *nana*, which is found in all parts of the range.

()

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness and health of sedentary, middle-aged men. The program consisted of three sessions per week, each lasting 45 minutes. The first session was a warm-up, the second was a cardiovascular workout, and the third was a strength training session. The results showed that the participants experienced significant improvements in their cardiovascular fitness, strength, and body composition. The study also found that the participants reported a decrease in their resting heart rate and an increase in their maximum heart rate. The authors conclude that a 12-week training program can effectively improve the physical fitness and health of sedentary, middle-aged men.

Dr. John W. B. ...

FesMed.com/Astral

ResMed.com/Astral

Supporting your patients' every breath

AstralTM series
life support ventilator

Because time and information are important, Astral gives you the tools to help provide quality patient therapy, close observation and informed decision making.

Versatile modes, circuits and interfaces. Adapt it to almost any different therapy mode, including the newly added IM-26. With comprehensive access single lead, single vector and double limb circuits, as well as multiple patient interfaces, you can cater for a wide range of patient types – from adult to paediatric patients (we give up to 6 kg), and those with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic hyperventilation syndrome (CHS), neuromuscular disease (NMD), special care conditions or critical care patients.


Supplemental oxygen: For patients requiring oxygen therapy, Astral allows flow rates of up to 30 L/min, which can deliver an FIO₂ of up to 100%.

Helping you provide confident care, the following technology can be fine-tuned to allow you to deliver therapy on a patient-to-patient basis for individualised comfort and synchrony.



For even more confident care, Astreal is available with cellular connectivity through ResMed Connectivity Module. This enables you to transmit therapy data straight from your patients' homes to AirView™, ResMed's securely-hosted, cloud-based patient management system for remote monitoring.

With secure access to daily online updates via AllView or AllView Exchange*, you can remotely view therapy reports and monitor trends as required without the need for manual downloads. You can perform timely interventions and feel well prepared for visits to home-based patients.



Day after day, Astral does what it does best: help clinicians provide quality ventilation wherever it's needed – in hospitals and homes of patients on life support – renewing their sense of independence and freedom.

Lightweight and discreet, Astral is designed to provide acute or long-term care to patients, even as they move through different care environments. A range of accessories is available to help staff with day-to-day tasks while also encouraging patients to continue with their day-to-day activities.



Battery options: With an original battery lasting up to 8 hours, and the capacity to add a further two external batteries, Astal's battery life can be stretched up to a total of 24 hours.



Mobility bags: When patients are unable to move away from the hospital or home, they make the device of two quarantined protective mobility bags that allow for uninterrupted ventilation on the go.





Homeostatic system: The body's ability to support regular blood glucose and care, but they can compensate with an appropriate amount of independence by keeping connected to someone or by social support systems.

When you bring any new device into a clinical environment, it is essential for your staff to find it easy to use. Knowing how to set up different patient conditions helps reduce time and resources spent on training.

Delivering quick and easy setup: Astral's intuitive navigation, user-friendly menus, and organizational aids, such as Setup Assistant, Learn Center and the "Walk-through" wizard system, not only streamline staff training, but also enable consistent and accurate patient setup.

Multiple programs: Using up to four printable programs, patients with treatment requirements that change in a particular condition (e.g., day/night or week/week) can be addressed. For example, a patient with a chronic condition may be treated on a weekly basis, but may require a different treatment protocol during a flare-up. The program can be treated easily from one therapy program to another without manual re-encoding.

Minimizing inventory and maintenance: Designed for a long working relationship, Acuda's first turnaround times and service are excellent. Acuda's first year (one year) reduced the number of installed units (one year) reduced the number of backup variables, saving both time and money.

[illegible]

CONFIRM COPY
ORIGINAL





ResMed

Informații de comandă



Astral 150 - APAC
27083



Astral 100 - APAC
27081



HumiCare D900



Cărucior de spital
27914



Pungă de mobilitate
Astral
27917



Pungă de mobilitate
Astral StimFit
27949



Suport de masă Astral
27915



Baterie externă
27918



Alarmă la distanță II
ROW 27902 (nu include
cablul)



Sondă netedă cu
circuit simplu, 22
mm, cu
QuickConnect



Set oximetrie cu senzor
moale reutilizabil
22370

Specificații tehnice



Astral 100



Astral 150

INDICAȚII DE UTILIZARE

Susținerea vieții pentru pacienții
de peste 5 kg

Susținerea vieții pentru pacienții
de peste 5 kg

CIRCUIT

Circuit simplu cu scurgere

Circuit simplu cu supapă

Circuit dublu

TERAPIE

Terapie prin circuit cu supapă:
CPAP, ACV, PACV, P-SIMV, V-SIMV, PS

Terapie prin circuit cu scurgere:
CPAP, ST, PAC

Respirație manuală

Respirație cu suspin (recrutare)

Ventilare prin apnee

Programe presetate

Volum și presiune

Volum și presiune

2

4

SETĂRI ȘI INTERVAL DE PRESIUNE

Presiune livrată (cm H₂O)

2-50 (circuit cu scurgere)
0-50 (circuit cu supapă)

2-50 (circuit cu scurgere)
0-50 (circuit cu supapă)

Volum curent livrat (cm H₂O)

Adult: 100 până la 2500 mL
Pediatrice: 50 până la 300 mL

Adult: 100 până la 2500 mL
Pediatrice: 50 până la 300 mL

Frecvență respiratorie

Adult: Oprit, 2 până la 50 bpm
Pediatrice: Oprit, 5 până la 80 bpm

Adult: Oprit, 2 până la 50 bpm
Pediatrice: Oprit, 5 până la 80 bpm

DATA

Monitorizare SpO₂

Optional

Optional

Monitorizare FIO₂

Optional

7 zile de date la rezoluție ridicată cu presiune de 25 Hz și
debit

Pe ecran și descărcare

Pe ecran și descărcare

365 zile de date centralizate

Pe ecran și descărcare

Pe ecran și descărcare

ALARME

Este disponibilă o gamă largă de alarme setabile,
inclusiv FIO₂ și SpO₂, dacă este conectat.

DIMENSIUNI

Greutate

3,2 kg

3,2 kg

Dimensiuni (L x l x İ)

285 mm x 215 mm x 93 mm

285 mm x 215 mm x 93 mm

Baterie internă

Baterie Litium-Ion,
14,4V, 6,6Ah, 95Wh,
8 ore timp de rulare

Baterie Litium-Ion,
14,4V, 6,6Ah, 95Wh,
8 ore timp de rulare

Nivel de putere a sunetului

43 ± 3 dBA*

43 ± 3 dBA*

Nivel de presiune a sunetului

35 ± 3 dBA*

35 ± 3 dBA*

CLASIFICĂRI CONFORM IEC 60601-1:

Echipament medical electric - cerințe generale pentru
siguranța de bază și performanța fundamentală.

Clasă II (izolație dublă) tip BF

Operare continuă

Adecvat pentru uz cu oxigen

* Măsurat conform IEC 60601-2-12:2011

CONFORM CU
ORIGINALUL

Caracteristici ale Astral




ResMed Ltd.
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
(pentru Astral)

**ResMed Humidification
Technologies GmbH**
Karneolstr. 4
72250 Freudenstadt
Germania (pt. HumiCare
HANA)

Distribuit de: ResMed Ltd, Bella Vista NSW Australia. Vizitați ResMed.com pentru informații ResMed din întreaga lume. Astral, HumiCare și QuickConnect sunt mărci comerciale și / sau mărci înregistrate a grupului de societăți ResMed. Specificațiile se pot modifica fără anunț prealabil. Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. ©2014 ResMed Ltd. 1017216/22014-12


CLAUDIU CRISAN
Aut. Nr. 30264/2010





ResMed

Astral™ series



CONFORM CU
ORIGINALUL



User guide
English

4 Internal battery indicator



5 Lock touch screen button

6 Menu bar

7 Bottom bar

8 Start/Stop ventilation button

9 Main screen

10 Sub-menus

11 Pressure bar

Note: Do not access Clinical mode  unless directed by a clinician.

Information bar

The Information bar is displayed at the top of the touch screen. The Information bar displays the operating status of the device, including patient type, current circuit configuration, programs, information messages, ventilation status, alarms and power status.



Description



Patient type – Adult



Patient type – Pediatric



Circuit type – Single limb with intentional leak



Circuit type – Single limb with expiratory valve



Circuit type – Double limb

P1 Program number and ventilation mode in use

(A)CV



Multiple alarms are active simultaneously. The highest priority active alarm is displayed first.

Message window

Will display alarms or information. Image above shows device in Standby. (Displayed when the device is powered on but not ventilating). Date and time will be displayed when the device is ventilating and there are no active alarms.

Information messages are displayed in blue text. If the device Alert tone setting is 'On', you will be alerted to new information messages by a single beep.

CONFORM CU
ORIGINALUL




Using the Astral device

Trends screen

The Trends screen shows the 5th and 95th percentile values, as well as the median for the last 30 days for each of the following parameters:

- Leak
- Minute ventilation
- Peak inspiratory pressure
- Tidal volume
- Respiratory rate
- Inspiratory time
- SpO₂
- Pulse rate
- FiO₂




Information is displayed as bar graphs, with two graphs per screen. Use the up and down scroll arrows to cycle through the graphs.

Setup menu

The Setup menu displays four different sub-menus:

- Circuit—to view the circuit
- Settings—to view the ventilation mode and access Manual Breath and Sigh Breath screens
- Data Transfer—to transfer data between the device and a personal computer via a USB stick
- Device Config.—to change the device configuration.



Assembling patient circuits

Circuit options

The Astral device supports a range of circuits with the use of interchangeable circuit adapters.


Breathing circuits may be of 10, 15 or 22 mm diameter.

The following table may assist in selecting suitable circuits and settings for different patient types

Tidal volume range	Recommended patient type setting	Suitable circuit diameters
50 mL to 300 mL	Pediatric	10 mm, 15 mm or 22 mm
> 100 mL	Adult	15 mm or 22 mm

Circuit adapters

There are three circuit adapters:




Adapter	For use with
1 Single limb leak 	Single limb circuit with intentional leak
2 Single limb 	Single limb circuit with expiratory valve (expiratory valve integrated into the circuit)
3 Double limb (Astral 150 only) 	Double limb circuit (expiratory valve integrated into the adapter) OR single limb circuit with intentional leak

A Learn Circuit should be performed after any change of circuit. Astral will provide accurate therapy as long as the Learn Circuit is passed. See Learn Circuit (see page 25).

To attach an antibacterial filter:

1. Fit the antibacterial filter to the inspiratory port of the device.
2. Connect the air tubing to the other side of the filter.
3. Perform the Learn Circuit function.
4. Attach the patient interface to the free end of the air tubing.



⚠ WARNING


- To prevent the risk of cross-contamination, an antibacterial filter is mandatory if the device is to be used on multiple patients.
- The expiratory module, internal antibacterial filter, expiratory flow sensor and cushion come into contact with exhaled gases but do not form part of the inspiratory pathway.

Adding supplemental oxygen

Oxygen may be prescribed by your clinician.

The Astral device is designed to be compatible with levels of supplemental oxygen up to 30 L/min.

At a fixed rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary depending on the Ventilation mode and settings, patient breathing pattern, mask selection, and leak rate.




CONFORM CU
ORIGINALUL



Technical specifications

Expiratory cycle (nominal) characteristics	Cycle occurs when inspiratory flow declines to the set percentage of peak inspiratory flow. Single limb with valve or double limb with valve: 5 to 90% Single limb with intentional leak: 8 to 50% (in five steps)
Sound pressure level	35 ± 3 dBA as measured according to ISO80601-2-12:2011.
Sound power level	43 ± 3 dBA as measured according to ISO80601-2-12:2011
Alarm volume range	59 - 89 dBA (in five steps)
Data storage	7 days of high-resolution airway pressure, respiratory flow and delivered volume (sampled at 25 Hz). 7 days of breath-related therapy data (sampled at 1 Hz). 365 days of statistical data per program.
Dimensions (L x W x H)	11.22" x 8.47" x 3.66" (285 mm x 215 mm x 93 mm)
Weight	7.1 lb (3.2 kg)
Inspiratory port / double limb adapter	22 mm taper, compatible with ISO 5356-1:2004 Anaesthetic & Respiratory Equipment – Conical Connectors
Pressure measurement	Internally mounted pressure transducers
Flow measurement	Internally mounted flow transducers
Power supply	AC 100–240V, 50–60Hz, 90 W 3.75 A continuous, 120 W / 5A peak 115V/400 Hz
External DC Power Supply	12 - 24V DC 90 W, 7.5 A / 3.75 A
Internal Battery	Lithium-Ion battery, 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh Operating hours (best case): 8 h with a new battery under normal conditions (see below). Test conditions: Adult, P(A)CV mode, P control: 20 cm H₂O, PEEP: Off, Rate: 15 bpm, Ti: 1.2 sec. Note: Time may vary with environmental conditions. Total lifetime: 3,000 hours of operation on internal battery Operating hours (worst case) > 4 hour run time under the following conditions: Test conditions: Adult, nonvented, PACV mode, Double limb circuit, Pressure Assist = 30 cm H₂O, PEEP = 20 cm H₂O Rate: 20 bpm, Ti: 1.0 sec, Rise Time = Off, Vts = off, Trig = Off. All other parameters remain at default settings.
Housing construction	Flame retardant engineering thermoplastic





Declaration of Conformity

Manufacturer:

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista
NSW 2153
Australia

EU Representative:

ResMed SAS
Par Technologique de Lyon
292 Allée Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
France

Notified Body:

TÜV SÜD Product Service
GmbH
Ridlerstraße 65
80339 München
Germany

Product: Astral 150

Intended Use: The Astral 100/150 provides continuous or intermittent ventilatory support for patients weighing more than 5 kg who require mechanical ventilation. The Astral device is intended to be used in home, institution/hospital and portable applications for both invasive and non-invasive ventilation.

Classification: IIb according to Rule 11

GMDN: 47083 Portable ventilator, electric

Conformity Assessment Route: Annex II (excluding Section 4), 93/42/EEC

We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national law of the provisions of Council Directive 93/42/EEC including the MDD amendment 2007/47/EC, for medical devices. Compliance to the MDD is applicable from the date listed below. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

This declaration is issued under the sole responsibility of ResMed Ltd.

EC Certificate Number: G1 17 08 49861 149

Signed at Sydney, Australia on: 16-Apr-18

Johanna Wright
Director of Regulatory Affairs
ResMed Ltd



EC129

First issued: 14-Nov-13

CONFORM CU
REGISTRUL

ResMed

CE
0123

Declarație de Conformitate

Producător:

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista
NSW 2153
Australia

Reprezentant UE:

ResMed SAS
Par Technologique de Lyon
292 Allee Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
Franța

Organism Notificat:

TUV SUD Product Service
GmbH
Ridlerstraße 65
80339 Munchen
Germania

Produsul:

Astral 150

Scopul utilizării:

Astral 100/150 oferă suport ventilator intermitent sau continuu pentru pacienți care cântăresc peste 5 kg care necesită ventilație mecanică. Dispozitivul Astral este destinat utilizării în locuințe, instituții/spitale și în aplicații portabile pentru ventilație invazivă și non-invazivă.

Clasificare:

IIb conform Regulii 11

Codul GMDN:

47063 Ventilator portabil, electric

Calea de Evaluare a Conformității: Anexa II (excluzând Secțiunea 4), 93/42/CEE

Declarăm prin prezenta că produsele menționate mai sus respectă transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei Consiliului 93/42/CEE inclusiv modificarea Directivei privind Dispozitivele Medicale 2007/47/CE. Conformitatea cu Directiva privind Dispozitivele Medicale se aplică de la data menționată mai jos. Toate documentele însoțitoare se păstrează la sediul producătorului.

Această declarație se eliberează pe răspunderea exclusivă a ResMed Ltd.

Certificat CE nr.: G1 17 08 49861 149

Semnat la Sydney, Australia pe: 16 aprilie 2018

Semnătură indescifrabilă

Johanna Wright
Director Afaceri de Reglementare
ResMed Ltd


EC129

Prima emitere: 14 noiembrie 2013

CONFORM CU
ORIGINALUL



[A large, faint, handwritten diagonal line is drawn across the page.]



UC 000000
000000



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 17 08 49861 149

Manufacturer: ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA



EC-Representative: ResMed SAS
Parc Technologique de Lyon
292 Allée Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
FRANCE

Product Category(ies): Positive Airway Pressure Devices,
Ventilators, Humidifiers, Masks,
Tubes and associated Accessories,
Patient Data Recorders (Respiratory).

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: JAQ235030142

Valid from: 2017-09-01
Valid until: 2021-10-03

Date, 2017-08-10

I. Preiß

Stefan Preiß



TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 2

CONFORM CU
ORIGINALUL





Product Service

EC Certificate**Full Quality Assurance System**

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 17 08 49861 149**Facility(ies):**

ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153,
AUSTRALIA

CONFORM CU
ORIGINALUL



Page 2 of 2

Certificat CE

Sistem Complet de Management al Calității

Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (DDM), Anexa II excluzând (4)
(Dispozitivele din Clasele IIa, IIb sau III)

Nr. G1 17 08 49861 149

Producător: ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Reprezentant CE: ResMed SAS
Parc Technologique de Lyon
292 Allee Jacques Monod
69791 Saint Priest Cedex
FRANȚA

Categorie(i) de Produse: Dispozitive de Presiune pozitivă în căile aeriene, Ventilatoare, Umidificatoare, Măști, Tuburi și Accesorii asociate, Înregistratoare Date Pacienți (respiratorii).

Organismul de Certificare al TUV SUD Product Service GmbH declară că producătorul menționat mai sus a implementat un sistem de management al calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a dispozitivelor/categoriilor de dispozitive conform Anexei II la Directiva privind Dispozitivele Medicale. Acest sistem de management al calității este conform cu cerințele acestei Directive și se supune supravegherii periodice. Pentru punerea pe piață a dispozitivelor de clasa III, este obligatoriu un certificat suplimentar Anexa II (4). A se vedea și notele de pe verso.

Nr. Raport: JAQ235030142

Valabil de la: 01.09.2017

Valabil până la: 03.10.2021

Data, 10.08.2017 *Semnătură indescifrabilă*
Stefan Preiß



TUV SUD Product Service GmbH este un Organism Notificat cu nr. de identificare 0123

Pagina 1 din 2

TUV SUD Product Service GmbH – Zertifizierstelle - Ridlerstraße 65 – 80339 München – MALL
Germania



CONFORM CU
ORIGINALUL

Certificat CE

Sistem Complet de Management al Calității

Directiva 93/42/CEE privind Dispozitivele Medicale (DDM), Anexa II excluzând (4)
(Dispozitivele din Clasele IIa, IIb sau III)

Nr. G1 17 08 49861 149

Unitate(Unități):

ResMed Limited

1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153,
AUSTRALIA

Pagina 2 din 2

TUV SUD Product Service GmbH – Zertifizierstelle - Ridlerstraße 65 – 80339 Munchen –
Germania

CONFORM CU
ORIGINALUL





Product Service

Certificate

No. Q5 049861 0154 Rev. 01

Holder of Certificate: ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Facility(ies): ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA

ResMed Asia Pacific Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution, Installation and Servicing of Positive Airway Pressure Devices, Ventilators, Humidifiers, Masks, Tubes and associated Accessories, Patient Data Recorders (Respiratory).

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: JAQ235039442

Valid from: 2019-07-10

Valid until: 2021-11-22

Date, 2019-07-10


I. Preiß

Stefan Preiß

Head of Certification/Notified Body



CONFORM CU
ORIGINALUL



Dakks Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

TUV SUD
Product Service

Certificat

Nr. Q5 049861 0154 Rev. 01

Titularul Certificatului:

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

Unitate(unități):

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA

ResMed Asia Pacific Limited
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista
NSW 2153, AUSTRALIA

Marca de Certificare:



Obiectul Certificatului:

Proiectarea și Dezvoltarea, Producția și Distribuția, Instalarea și Întreținerea Dispozitivelor de Presiune pozitivă în căile aeriene, ventilatoarelor, umidificatoarelor, măștilor, tuburilor și accesoriilor asociate, înregistratoarelor de date (respiratorii) pentru pacienți.

Standard(e) Aplicat(e):

EN ISO 13485:2016
Dispozitive medicale – Sistem de management al calității
Cerințe în scopuri de reglementare
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016



CONFORM CU
ORIGINALUL



Organismul de Certificare al TUV SUD Product Service GmbH atestă că societatea menționată mai sus a stabilit și menține un sistem de management al calității care îndeplinește cerințele standardului(standardelor) menționat(e). A se vedea notele de pe verso.

Raportul nr.: JAQ235039442

Valabil de la: 10.07.2019

Valabil până la: 22.11.2021

Data, 10.07.2019

Semnătură indescifrabilă

Stefan Preiß

Directorul Organismului de Certificare/Notificat


Pagina 1 din 1

TUV SUD Product Service GmbH – Zertifizierstelle - Ridlerstraße 65 – 80339 Munchen –
Germania

CONFORM CU
ORIGINALUL



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefan Preiß".





MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

DECLARAȚIE GENERALĂ
Lot 2 - Ventilator de transport

Subsemnatul, BIȚU Cristian-Florin, reprezentant legal al SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL, cu sediul în str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4, sector 2, București, în calitate ofertant la INVITAȚIE PARTICIPARE – Negociere fara publicarea unui anunt de participare nr. 16115/28.04.2020, pentru achiziția de „Achiziționare echipamente medicale (3 loturi)” lot 2 Ventilator de transport, la data de 30.04.2020, organizată de Spital Clinic Județean de Urgență Arad, îndeplinesc următoarele condiții:

- Durată garanție: 24 luni;
- Termenul de livrare: maxim 45 zile;
- Transport: gratuit până la sediul beneficiarului;
- Instalarea, punerea în funcțiune: se va face gratuit la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la semnarea pv de recepție cantitativă;
- Instruirea/scolarizarea personalului: se va efectua gratuit la sediul beneficiarului pentru aprox. 6 persoane, în limba română;
- SC EYECON MEDICAL SRL asigura:
 - o Aparatura/produsele noi
 - o Piese de schimb și materiale consumabile
 - o Mentenanța preventivă în perioada de garanție
 - o Mentenanța corectivă în perioada post-garanție
 - o Suport tehnic

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	6 ore	A doua zi lucrătoare	A doua zi lucrătoare

Data completării: 29.04.2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL
BIȚU Cristian-Florin

Administrator







MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Str. Andreny Karoly, nr. 2-4, Arad, jud. Arad

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SC MEDICAL LOGISTIC MALL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm "lot 2 Ventilator de transport", pentru suma de 144.000,00 lei (osutapatruezecisipatrumiilei) exclusiv TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 27.360,00 lei (douazecisipsapteimitreisutesaizecilei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm "lot 2 Ventilator de transport" și să asigurăm toate serviciile conexe/suport furnizării precizate în documentația de atribuire în termenul de livrare impus prin documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta ofertă primită.

Data 29/04/2020

Cristian-Florin Bițu, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele MEDICAL LOGISTIC MALL



MEDICAL LOGISTIC MALL s.r.l.
Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10, mezanin, camerele 3 și 4
cod 020223, sector 2, București
office@medicalmall.ro www.medicalmall.ro

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Anexa la Formularul de oferta

Nr. Lot	Denumirea achiziție	UM	Cantitate	Pret unitar fara TVA Lei	Valoarea totala fara TVA Lei
2	Ventilator de transport	Buc.	3	48.000,00	144.000,00
Valoare TVA				27.360,00 lei	
TOTAL Valoare cu TVA				171.360,00 lei	

Data 29/04/2020

SC MEDICAL LOGISTIC MALL
Cristian-Florin Bițu,
Administrator



RO 22672401; J40 / 20518 / 2007; Cont RO90 BACX 0000 0001 9557 0000 - UNICREDIT TIRIAC BANK, Dorobanti - Bucuresti